

ଅଧ୍ୟାୟ 4

ଡ୍ରଗ୍ସ, ଔଷଧ, ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା

ଜନସାମ୍ମୁ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯୋଗାଣରେ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ / ଗୁରୁତର ଡ୍ରଗ୍ସ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ । ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ଶୁଖିଲାବେଳେ ତଦାରଖ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । କିଣାଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଫଳପ୍ରସାଦୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଜନସାମ୍ମୁ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମ୍ମୁ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ । ଆଇପିଏସ୍/ଏସ୍/ଏମ୍ସି ଫାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇନଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ଭିଡିଓସ୍କୋପି ଏବଂ ଫାନଦ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ନଥିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଶ୍ଚିତ / ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତତା ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମ୍ମୁ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଏମ୍ସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା । ଏମ୍ସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ଉଦାହରଣ ଥିଲା ।

ଭିଡିଓସ୍କୋପି ଏବଂ ଫାନଦ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ନ ଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଅମ୍ନୁଜାନ କନସେଣ୍ଟରେଟର ଇତ୍ୟାଦି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଏକ ଉତ୍ତମ ଜନସାମ୍ମୁ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିରାପଦ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଡ୍ରଗ୍ସର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସୁଲଭତା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଜନସାମ୍ମୁ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ<sup>80</sup> ଯୋଗାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ) ରାଜ୍ୟରେ 'ମାଗଣା ଔଷଧ ବିତରଣ ଯୋଜନା' ଅରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ମୁ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ, ଔଷଧ, ସର୍ଜିକାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ଏବଂ ବିତରଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍(ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍) କୁ ଦାୟାଦ୍ୱି ଦିଆଯାଇଛି । ଔଷଧ, ସର୍ଜିକାଲ୍ ଏବଂ ଇଏଫ୍ (ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର)ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଲୋଚନା ଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଦାୟା ଅଟେ । ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ (ଏପ୍ରିଲ 2017)ରେ ପ୍ରୟୋଗ, ଯୋଗାଣ ଶୁଖିଲା ପରିଚାଳନାକୁ ସମ୍ବଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା କ୍ରୟ, ବର୍ଷନ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ, ଇ-ନିରାମୟା ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ।


ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରଗ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ଏବଂ ବିତରଣର ସମାକ୍ଷାଯାତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମାକ୍ଷା ପୂର୍ବଦେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସି ଆଣ୍ଡ ଏଜିର ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ (ଜିଆଣ୍ଡଏସ୍ଏସ୍ଏ) ରେ ରହିଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1) । ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମାକ୍ଷାରେ, ଜନସାମ୍ମୁ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରଗ୍ସ, ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ସଂପୃକ୍ତ ସମାକ୍ଷା ପୂର୍ବଦେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

<sup>80</sup> ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଅଧିକାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମୟରେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ (ଯଥା-ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍, ବିତରଣ ଏବଂ ରୋଗୀର ବ୍ୟବହାର), ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ଚିକିତ୍ସା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ୍ ।

**4.1 ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଣ**

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କ୍ରୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ତଥା ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (2015) ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ଲକ୍/ ଜିଲ୍ଲା/ ମେଡିକାଲ କଲେଜ୍ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧର ବାର୍ଷିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଉଚିତ୍, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ ତାଲିକା (ଇଡିଏଲ୍) ଏବଂ ମାନକ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ଏସ୍ଟିଜି)ରେ, ଏହାକୁ ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ରେ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଚାଲୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବାର୍ଷିକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍, ଡେଣ୍ଟ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳନ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରିଚାଳନା (ଏସ୍ଟିଏମ୍ସି) କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ, ଏସ୍ଟିଏମ୍ସି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୟ ଯୋଜନା (ଏପିପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏପିପି କୁ ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଏସ୍ଟିଏମ୍ସି) ରେ ରଖିବା । ଏସ୍ଟିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏପିପି ଅନୁମୋଦନ ପରେ, ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅତିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଚାର୍ଟ 4.1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

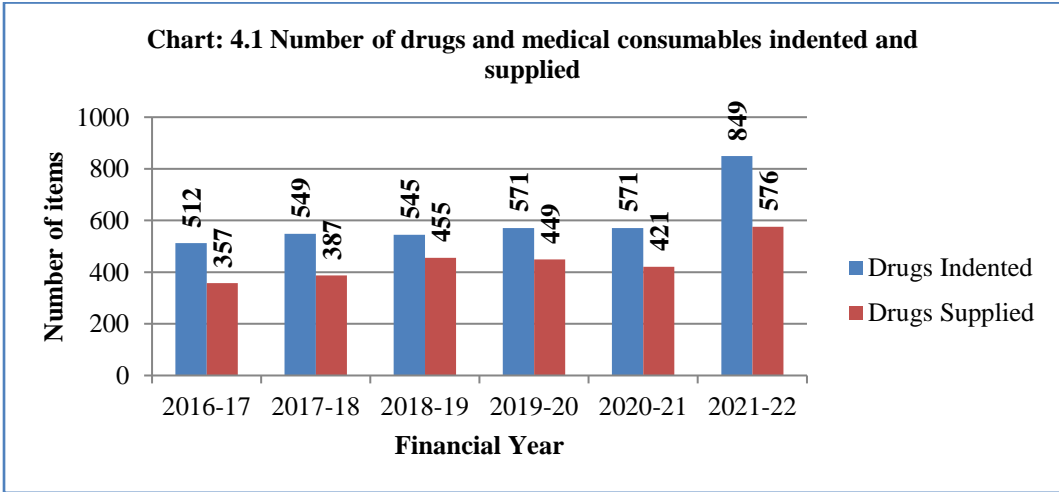

(ଉତ୍ସ: ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅଭାବ ରହିଛି । 512 ରୁ 849 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତୁଳନାରେ, 357 ରୁ 576 ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତାର 68 ରୁ 83 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ଏକକ ବିଡ୍/ ଅଣ-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବିଡ୍/ କ୍ରୟ ଆଦେଶର ଆଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସର ସଞ୍ଚ ଯୋଗାଣକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ।

ଡେଣ୍ଟ୍ରୀ, 2,219.28 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ, ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ କେବଳ, 1,044.64 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ ଯୋଗାଇପାରିଲା, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତାର 47 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହିପରି, ଇଣ୍ଡେକ୍ସଡ୍ ପରିମାଣର 53 ପ୍ରତିଶତ ସଞ୍ଚ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବାରୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର ବିବରଣୀ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ, ସାରଣୀ 4.1 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.1: 2019-20 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍/ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ

ଡିଏଚ୍ଏଚ୍	ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁମୋଦିତ		ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ		ସଙ୍କ୍ରମ ଯୋଗାଣ	
	ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ (କୋଟିରେ)	ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ (କୋଟିରେ)	ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ (କୋଟିରେ)
ଭଦ୍ରକ	1,433	56.95	944	23.56	489	33.39
ଢେଙ୍କାନାଳ	1,329	32.90	982	20.2	347	12.7
କନ୍ଧମାଳ	1,441	28.71	944	13.08	497	15.63
ନବରଙ୍ଗପୁର	2,473	28.84	1,553	21.11	920	7.73
ନୂଆପଡ଼ା	1,410	16.87	919	8.83	491	8.04
ପୁରୀ	1,275	NF*	1,150	NF*	125	NF*
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	1,165	48.12	1,002	22.53	163	25.59
ଏମ୍ସିଏଚ୍, ବାରିପଦା	1,318 <sup>81</sup>	7.61	768	2.75	550	4.86
ଏମ୍ସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର	2,708	20.17	2,380	17.10	328	3.07
<b>ମୋଟ</b>	<b>14,552</b>	<b>240.17</b>	<b>10,642</b>	<b>129.16</b>	<b>3,910</b>	<b>111.01</b>

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଇ-ନିରୀମୟ ଡାଟାବେସର ରେକର୍ଡ)

\* ଏନ୍ ଏଫ୍: ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଏହିପରି, 13,277<sup>82</sup> ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମ୍ପ୍ଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର 240.17 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ 129.16 କୋଟି (54 ପ୍ରତିଶତ) ଯୁନିଟ୍ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସାମ୍ପ୍ଲ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଯୋଗାଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା/ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପରିମାଣ ତୁଳନାରେ ସଙ୍କ୍ରମ ଏବଂ ଅଧିକ ଯୋଗାଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ପରି ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ତରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଅବଧି ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ।

ସାମ୍ପ୍ଲ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

#### 4.1.1 ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର ଅର୍ଯ୍ୟୋକ୍ତିକ ଯୋଗାଣ

ଅନୁମୋଦିତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ପ୍ଲ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଏବଂ 2019-22 ଅବଧି<sup>83</sup> 2019-22 ପାଇଁ ‘ଇ-ନିରୀମୟ’ ଡାଟାବେସର ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ, ଅତିବ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ **ପରିଶିଷ୍ଟ 4.1** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ/ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପରିମାଣ ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ସଙ୍କ୍ରମ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗାଣ କରିଥିଲେ । ଅତିବ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ:

81 ଏହା ଦୁଇଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯଥା 2020-21 ଏହିପରି 2021-22 ଯେହେତୁ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା  
 82 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ (14,552 - 1,275)  
 83 ଇ-ନିରୀମୟ ଡାଟାବେସରେ ତଥ୍ୟ 2016-17 ରୁ 2018-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା

- ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ 2019-20 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ/ ସ୍ଥାନିକର 30 ରୁ 73 ପ୍ରତିଶତ ଅଭାବ, 205 ରୁ 564 ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ପିଆର୍ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ରେ ଅଭାବ 38 ରୁ 45 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ଏହା 7 ରୁ 14 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହିପରି ସକ୍ଷମ ଯୋଗାଣ ଜିଲ୍ଲାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ।
- ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣରୁ ଅଧିକ ରୁ 18 ରୁ 123 ପ୍ରକାରର ଡ୍ରଗ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 2019-20 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ 40 ରୁ 297 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୋଦାମ (ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍) ରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗଚ୍ଛିତର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 4.1.6** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
- ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ 82 ରୁ 504 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିଲା । ଡ୍ରଗ୍ସର ସକ୍ଷମ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଗାଣରୁ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିର ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ (ଜିଆଣ୍ଡଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏ) ର **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.7** ରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ।
- ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2018-19 ପାଇଁ ଇ-ନିରାମୟ ତାଟାବେସରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ବାହାନାରେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଏହିପରି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁମୋଦିତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ/ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ମେଳ ଖାଉ ନଥିଲା, ଯାହା ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭାବୀ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

**4.1.2 ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜଟିଳ ଡ୍ରଗ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍**

ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ ତାଲିକା (ଇଡିଏଲ୍) ଉପରେ ଆଧାର କରି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟକ୍-ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍, ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଷ୍ଟକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି (ସାରଣୀ 4.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି) ।

**ସାରଣୀ 4.2: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଡ୍ରଗ୍ସର ଷ୍ଟକ୍**

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସ୍ତର	ଉପଲବ୍ଧ ଡ୍ରଗ୍ସର ସଂଖ୍ୟା		ସର୍ବନିମ୍ନ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା
	2016-17 ରୁ 2019-20	2020-21 ରୁ 2021-22	
ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍	263	542	ଗୋଟିଏ ମାସର ଷ୍ଟକ୍
ସିଏଚ୍‌ସି	172	542	ଦୁଇ ମାସର ଷ୍ଟକ୍
ପିଏଚ୍‌ସି	87	295	ତିନି ମାସର ଷ୍ଟକ୍

(*ଉତ୍ସ: ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ*)

ଅତିରିକ୍ତ, ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ନମୁନା ହୋଇଥିବା ମାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଡ୍ରଗ୍ସର ଅଣ/ ସକ୍ଷମ ଯୋଗାଣ ହେତୁ ଏହା ଘଟିଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ଥାନୀୟ

ଭାବରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ନମୁନା ମାସରେ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍/ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଷକ୍-ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 4.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.3: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଷକ୍

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍/ଏମ୍‌ସିଏଚ୍	ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଷକ୍ ଆଉଟ୍ ଔଷଧର ପ୍ରତିଶତ					
	ମଇ-16	ଅଗଷ୍ଟ-17	ନଭେମ୍ବର-18	ଫେବୃଆରୀ-20	ମଇ-20	ଅଗଷ୍ଟ-21
ଭଦ୍ରକ	27	24	27	26	62	68
ଢେଙ୍କାନାଳ	48	27	31	24	57	59
କନ୍ଧମାଳ	14	20	10	5	16	15
ନବରଙ୍ଗପୁର	2	2	2	3	1	1
ନୂଆପଡ଼ା	58	38	24	18	62	59
ପୁରୀ	0	22	5	6	4	2
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	14	11	16	12	53	49
ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦା	NA	5	6	3	6	5
ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର	19	19	14	25	12	11

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଡିପ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ)

(ଲାଲ ରଙ୍ଗ: 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଷକ୍ ଆଉଟ୍ ହାଲୁକା ଲାଲ: 50 ପ୍ରତିଶତ ରୁ କମ୍ ଷକ୍ ଆଉଟ୍)

ଏହିପରି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଷକ୍, ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା<sup>84</sup> ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି, ମଇ 2020 ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2021 ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା । କ୍ଲୋରଫେନିରାମାଲନ୍, ମ୍ୟାଲେଟ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ (ଆଣ୍ଟି-ଆଲର୍ଜି ଡ୍ରଗ୍), କ୍ଲୋପିଡୋଗ୍ରେଲ୍ ଟାବଲେଟ୍ (ଆଣ୍ଟି-ଆର୍ଟିନାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍), ଡେକ୍ସାମେଥୋସୋନ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ (ଆଣ୍ଟି-ଆଲର୍ଜି ଡ୍ରଗ୍) ବେଟାମେଥୋସୋନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଫସ୍‌ଫେଟ୍, ଇଞ୍ଜେକ୍ଟନ୍ (ଆଣ୍ଟି-ଆଲର୍ଜି) ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା-ନମୁନା ହୋଇଥିବା ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 14 ଟି ସିଏଚ୍‌ସିରେ 16ରୁ 72 ପ୍ରତିଶତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ 13 ସିଏଚ୍‌ସିରେ ହାରାହାରି 2016-22 ର ନମୁନା ମାସରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ସିଏଚ୍‌ସିରେ କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।

### 4.1.3 ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଅଣ-ଉପଲବ୍ଧତା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ନଭେମ୍ବର 2018) 106 ଟି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ତାଲିକାଭିତ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା କଥା । ଅତିର୍ତ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, 2018-22 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ୟୟନ ପାଇଁ, 3 ରୁ 410 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ରୁ 59 ଟି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ଯାହା ସାରଣୀ 4.4 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

<sup>84</sup> ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍: ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ସାରଣୀ 4.4: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଟିଳ ଡ୍ରଗ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକ ଆଉଟ୍ (ଦିନର ଅବଧି)

ଡିଏର୍ଏଚ୍/ଏମସିଏଚ୍	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	ଡ୍ରଗ୍ସର ସଂଖ୍ୟା	ଷ୍ଟକ ଆଉଟ୍ ଅବଧି	ଡ୍ରଗ୍ସର ସଂଖ୍ୟା	ଷ୍ଟକ ଆଉଟ୍ ଅବଧି	ଡ୍ରଗ୍ସର ସଂଖ୍ୟା	ଷ୍ଟକ ଆଉଟ୍ ଅବଧି	ଡ୍ରଗ୍ସର ସଂଖ୍ୟା	ଷ୍ଟକ ଆଉଟ୍ ଅବଧି	ଡ୍ରଗ୍ସର ସଂଖ୍ୟା	ଷ୍ଟକ ଆଉଟ୍ ଅବଧି
ଭଦ୍ରକ	NA	NA	15	31-410	15	23-163	8	28-212	20	14-243
ଡେଙ୍କାନାଳ	47	30-365	14	30-365	8	60-270	4	90-365	17	30-365
କନ୍ଧମାଳ	11	30-365	14	30-365	12	30-300	11	30-150	8	30-244
ନବରଙ୍ଗପୁର	0		0	0	0		0		0	0
ନୂଆପଡ଼ା	12	60-210	10	30-120	9	30-210	5	30-365	3	30-120
ପୁରୀ	0		0		0		0		6	30-365
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	14	92-365	13	91-365	18	91-365	13	90-365	12	121-365
ଏମସିଏଚ୍, ବାରିପଦା	14	15-273	26	28-365	39	13-345	5	31-365	11	28-365
ଏମସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର	43	9-320	59	6-317	34	8-339	24	4-189	28	3-365

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏର୍ଏଚ୍ ଏବଂ ଏମସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକ ରେକର୍ଡ)

ପରୀକ୍ଷଣରେ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସେଫାଡ୍ରକ୍ଲିଲ୍ (250 ମିଗ୍ରା) ଟାବଲେଟ୍, ଡ୍ରୋଟାଭେରାକ୍ସନ୍ (40 ମିଗ୍ରା) ଟାବଲେଟ୍, ଗ୍ଲାଇମିପିରାଇଡ୍ (2 ମିଗ୍ରା) ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ନିଫେଡିପାଇନ୍ ଏସ୍ଆର୍ (20 ମିଗ୍ରା) ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଇଟ୍ୟାପି ଜଟିଳ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପଲବ୍ଧତା ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସିଏଚ୍ସି ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟିରେ<sup>85</sup>, 11 ରୁ 35 ଗୁରୁତର ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟକ ବାହାରେ ଥିଲା, ହାରାହାରି 8 ରୁ 366 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାରାହାରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ । ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସିଏଚ୍ସି ଗୁଡ଼ିକରେ, 2019-20 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଦୁଇରୁ ନଅଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ/ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସର ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ହେତୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଦିଆଯାଇନାଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଗାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ମାଗଣା ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ।

ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀ ଭଦ୍ରକ କହିଲେ (ଜୁନ୍ 2022) ଯେ, ଷ୍ଟକ ଆଉଟ୍ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ସମାନ/ ବଦଳକାରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

#### 4.1.4 ଡ୍ରଗ୍ସ ବିତରଣ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କ୍ରୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2015 ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ଡିଡିସି) ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିତରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ସେଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ସମନ୍ୱୟ ତଥ୍ୟ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପରେ ଡିଡିସି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ

<sup>85</sup> ବରପଦା; ବାସୁଦେବପୁର; ଖଜୁରିକଟା; କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା; ଲହୁଣୀପଡ଼ା; ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର; କୋମଳା; ଖରିଆର ରୋଡ଼



ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ତାହା ଏବଂ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଡିଡିସିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଡିଡିସି ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିଥିବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଆଇସିଏଚ୍‌ଏସ୍ 2012 ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ 200 ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡିଡିସି ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମିଳିତ ସରଜମିନ୍ ତଦତ୍ତ (ମଇ-ଜୁଲାଇ 2022) ତାତ୍ତ୍ୱଗଣାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ସାରଣୀ 4.5 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବୁ ଛଅଟି ଡିଡିସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସାରଣୀ 4.5: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଡିସିର ଉପଲବ୍ଧତା

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍/ଏମସିଏଚ୍	ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ଓପିଡି ରୋଗୀ <sup>86</sup>	ଆବଶ୍ୟକତା	ଡିଡିସି ସଂଖ୍ୟା
ଭଦ୍ରକ	930	5	4
ଦେଙ୍କାନାଳ	860	4	2
କନ୍ଧମାଳ	589	3	2
ନବରଙ୍ଗପୁର	234	1	1
ନୂଆପଡ଼ା	263	1	2
ପୁରୀ	1,338	6	6
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	637	3	6
ଏମସିଏଚ୍, ବାରିପଦା	1,213	6	3
ଏମସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର	2,246	11	6

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଏବଂ କେପିଆଇ ବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

(ଲାଲ ରଙ୍ଗ: ଡିଡିସିର ଅଭାବ; ସବୁଜ ରଙ୍ଗ: ଅଭାବ ନାହିଁ)

ଉପରୋକ୍ତରୁ ଏହା ଦେଖାଯିବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ତୁଳନାରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଏବଂ ଏମସିଏଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚୋଟିରେ ଡିଡିସିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଡିଡିସି ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ସୁଗମ ବିତରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ଥିବା ଛଅଟି ଡିଡିସି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭବନରେ ଏବଂ ଚାରିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଛଅଟି ଡିଡିସିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନାନର୍ ସହିତ କେବଳ ଦୁଇଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର/ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଛଅଟି କାଉଣ୍ଟର ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କ୍ୟାପଚର୍ ଏବଂ ସ୍ନାନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ଏହିପରି, ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ନଦେଇ ଛଅଟି ଡିଡିସି ସୃଷ୍ଟି ରୂପା ଥିଲା ।
- ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ସ୍ନାନର୍ ସମେତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ସିଷ୍ଟମର ଅଣ-ଉପଲବ୍ଧତା/ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ, ତଥ୍ୟ କ୍ୟାପଚର୍ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସ୍ନାନିଂ କେବଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟବହାର ପଛଟି ଏବଂ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖା ଉପରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସମୀକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
- ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକର ଡିଡିସିରେ ଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟେନର/ ଟ୍ରେ/ କ୍ରାସ୍ କାର୍ଟରେ ଗଢ଼ିତ ହେଉ ନଥିଲା ଏବଂ ଲେବଲ୍ ହୋଇନଥିଲା । ଅଣ-ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଔଷଧ ବିତରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଆଗଲା । ଡିଡିସିର ଅଜ୍ଞାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡ୍ରଗ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କାରଣ 800-900 ରୋଗୀ ହାରାହାରି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରହଣ ଔଷଧ କରୁଥିଲେ ।

<sup>86</sup> 2016-22 ସମୟରେ ତାତ୍ତ୍ୱଗଣାନାର ଓପିଡି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ହାରାହାରି ରୋଗୀମାନେ ଗଣନା ହୋଇଛି

- ପିଆରଏମ୍ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଡିଡିସି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି, ନିରାମୟ ଡାକ୍ତରୀରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2020 ଠାରୁ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଡିଡିସିରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ସ୍କାନିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଏମ୍ସିଏଚ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା 71.33 ଲକ୍ଷ ଓପିଡି ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 25.13 ଲକ୍ଷ (35 ପ୍ରତିଶତ) ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ବ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 65 ପ୍ରତିଶତ ଓପିଡି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଏମ୍ସିଏଚ୍ରେ ମାଗଣା ଔଷଧ ବ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ସାମଗ୍ରୀକ ବିପଦକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ରୋଗୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସର ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ ହେତୁ କିମ୍ବା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଡିଡିସିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ପାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।



ଡ୍ରଗ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକର ଡିଡିସିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଓପିଡି ରୋଗୀ (4 ଜୁନ୍ 2022)

ଡ୍ରଗ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ବେଙ୍ଗାଳା ଡିଡିସିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଓପିଡି ରୋଗୀ (9 ମଇ 2022)

ଏହିପରି, ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ପାଇବାକୁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଏବଂ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

**ସୁପାରିଶ 4.1**

ସମସ୍ତ ଡିଡିସି ଗୁଡ଼ିକରେ, ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପିଏଚ୍ସି ଗୁଡ଼ିକରେ, ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ, ରିଆଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭିତ୍ତିରେ, ନିଗମର ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପିଏଚ୍ସି ଗୁଡ଼ିକରେ, ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଏକ ରିଆଲ୍-ଟାଇମ୍ କନଭେଣ୍ଟୋରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଇବା ଉଚିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିକିଯାଏ, ଅଧିକ ରାହିବା ହେତୁ କିମ୍ବା ଔଷଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଧାର ଗତି/ ରାହିବା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ/ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଜ୍‌ଫ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଉଚିତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।



### 4.1.5 ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ‘ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ମାଗଣା ବ୍ୟୟନ ନୀତି’(2013) ଅନୁଯାୟୀ “ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ନିରାପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଶୃଙ୍ଖଳ ଚେନ୍ ସୁବିଧା ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୋଦାମ ପାଇଁ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବ” ।

ଏନ୍-ଏର୍-ଏମ୍ ଆସେସର ଗାଇଡ୍ ପୁସ୍ତକ, ରୋଗୀକୁ ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟୋରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ପ୍ରଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ।

ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲେ ଯେ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଗୋଦାମ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପାରାମିଟର ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ । ତୁଟି/ ତୁଟି, ଡିଡ୍ରାମାଏଟ୍ ଏବଂ ଉପ-ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ସାରଣୀ 4.6 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.6: ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅଭାବ

ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକ	ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ	ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଭାବ
ଲେବଲ୍ ହୋଇଥିବା ସେଲଫ୍ / ଥାକ	ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଡ୍ରାମାଏଟ୍ରେ ଲେବଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଆଂଶିକ ଏବଂ ପିଆର୍-ଏମ୍, ଏମ୍-ସି-ଏର୍ ସର୍-ଷ୍ଟୋର ଥିଲା । ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଡି-ଏର୍-ଏର୍, ଉତ୍ପାଦ, କାନ୍ଥାଲ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ।	ଜାଗା ଏବଂ ଥାକର ଅଭାବ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଔଷଧର ଅଜ୍ଞାନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇଥାଏ, ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ (ବାକ୍ସ୍) ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରଖିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ବିତରଣରେ ଅଧିକ କାରବାର ସମୟ ଏବଂ ଗଢ଼ିତ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ସୀମିତ ଔଷଧ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର	ଉତ୍ପାଦର ଡି-ଏର୍-ଏର୍/ ଡିଡ୍ରାମାଏଟ୍ ରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା	ବିପଦଜନକ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକୃତ ପ୍ରବେଶ
ସମାପ୍ତି/ଏନ୍-ଏସ୍-କ୍ୟୁ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୃଥକ ସେଲଫ୍/ ଥାକ	ଜାଗା ଅଭାବ ହେତୁ ଡିଡ୍ରାମାଏଟ୍, ଉତ୍ପାଦ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଗଢ଼ିତ ହୋଇଥିଲା । ତୁଟି ଏମ୍-ସି-ଏର୍ରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।	ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ
ଚଟାଣରେ ଗଢ଼ିତ ଏବଂ କାନ୍ଥା ପାଖରେ ଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ୍	ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡି-ଏର୍-ଏର୍ ଏବଂ ଏମ୍-ସି-ଏର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚଟାଣରେ ଏବଂ ଡିଡ୍ରାମାଏଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କାନ୍ଥା ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।	ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ନ ଥିବାରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ଫଳପ୍ରସୂତା ଏବଂ ସେଲଫ୍ ଜୀବନ ହରାଇଥାଏ ।
ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଫାର୍ମାସା	ଡି-ଏର୍-ଏର୍, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଏମ୍-ସି-ଏର୍, ବାରିପଦାରେ ଫାର୍ମାସିଗୁଡ଼ିକର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ନଥିଲା । ଉତ୍ପାଦରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏସିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା ।	
କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ / ସିଏମ୍-ଏମ୍ ଉପଲବ୍ଧତା	ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଡ୍ରାମାଏଟ୍/ ଡି-ଏର୍-ଏର୍ରେ ରେକର୍ଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	
ଗଭୀର ଫ୍ରିଜର ତାପମାତ୍ରା ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଡ୍ରାମାଏଟ୍/ ଡି-ଏର୍-ଏର୍ରେ ରେକର୍ଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	
ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କ୍ଷେତ୍ରର 24- ଘଣ୍ଟା ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡିଂ	କୌଣସି ଡିଡ୍ରାମାଏଟ୍/ ଡି-ଏର୍-ଏର୍ରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ	

(ଉତ୍ସ:ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଜେପିଆଇର ରେକର୍ଡ୍)

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

- ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲା । ଡିଏଚଏଚ୍/ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ସବୁ ପରିମାଣର ପୋଗ୍ରାମ ତୁରନ୍ତ<sup>87</sup> ଗ୍ରହଣ ହେବୁ ଏନଏସକ୍ୟୁ/ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁରନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବିସର୍ଜନ ନ କରିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲା ।
- ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ଚାର୍ଜ, ସମସ୍ତ ଡିଏଚଏଚ୍ରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇନଥିଲା ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ଡିଏଚଏଚ୍ରେ ଶୀତଳ ଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ, ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସ ବ୍ୟକ୍ତି (ଡ୍ଫୋର୍ ମ୍ୟାନ୍) ଶୀତଳ ଶୃଙ୍ଖଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ।
- ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ଥିବା ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କୌଣସି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଥିଲା । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚଏଚ୍ରେ/ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଡିଏଚଏଚ୍ ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ଏକ ଷ୍ଟୋର ରୂପେ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ଵରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଚଟାଣ, ସିଡି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କୋଠାଟି ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଏହା ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କଥା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା ।
- ପିଆରଏମ୍ ଏମସିଏଚ୍ରେ କୌଣସି ଉତ୍ତରୀକୃତ ଉପ ଷ୍ଟୋର ଉପଲବ୍ଧ ଓନାହିଁ । ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସେଲଫ୍/ ଥାକ ବିନା ସର୍ବ ଷ୍ଟୋର, ଏମସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ଏକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।



ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ତାତ୍ତ୍ଵରୀତାଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏନଏଚଏମ୍ ଆସେସର ଗାଇଡ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ତୁରନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ତୁରନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ତୁରନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

<sup>87</sup> ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜଡ଼ିତ ତୁରନ୍ତ ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି

### 4.1.6 ଷ୍ଟକ୍ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ଔଷଧର ତାରିଖ ସମାପ୍ତି

ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର ଅତିରିକ୍ତ ତଥା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଷ୍ଟକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ । ଔଷଧର ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଇ-ନିରାମୟ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିରନ୍ତର ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସୂଚନାର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 4,638 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ (6.07 କୋଟି ଯୁନିଟ୍) ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 11.68 କୋଟି ଟଙ୍କା । 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ତାରିଖ ଗଢ଼ି ଯାଇଛି । ଅତିକ୍ରମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଅପ୍ରେଲ 2017 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିସଟ୍ରୀବ୍ୟୁଟ୍/ଏମ୍‌ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ 2.90 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ତାରିଖ ଗଢ଼ି ଯାଇଛି । ସେହି ତାରିଖ ଗଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଜିଲ୍ଲା ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଉପ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା ସାରଣୀ 4.7 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.7: ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

ଡିସଟ୍ରୀବ୍ୟୁଟ୍/ଏମ୍‌ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ/ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ସଂଖ୍ୟା	ସଂଖ୍ୟା (ୟୁନିଟ୍)	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
ଭଦ୍ରକ	160	79,85,535
ଦେଙ୍କାନାଳ	167	28,91,253
କନ୍ଧମାଳ	160	1,88,162
ନବରଙ୍ଗପୁର	140	5,49,281
ନୂଆପଡ଼ା	298	47,47,764
ପୁରୀ	218	12,18,946
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	245	86,49,068
ଏମ୍‌ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍, ବାରିପଦା	76	20,45,661
ଏମ୍‌ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର	114	6,90,329
<b>ମୋଟ</b>	<b>1,578</b>	<b>2,89,65,999</b>

(ଉତ୍ସ: ସାତଟି ପରୀକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ସର ସମାପ୍ତି ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଇ-ନିରାମୟ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଗ୍ସର ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ, ବ୍ୟୟ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗାଣ, ଅବାସ୍ତବ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ କ୍ରମ ପରେ ଡ୍ରଗ୍ସର ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡ୍ରଗ୍ସର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହିପରି କିଛି ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

- ଡିସଟ୍ରୀବ୍ୟୁଟ୍ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଡିସଟ୍ରୀବ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ 33.53 ଲକ୍ଷ ମେଟଫର୍ମିନ୍ (500 ମିଗ୍ରା) ଟାବଲେଟ୍ (ମୂଲ୍ୟ 7.94 ଲକ୍ଷ) 2020-21 ରୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଅବାସ୍ତବ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.8: ସେଫାଡ୍ରକ୍ସିଲ୍ 500 ମିଗ୍ରା ଟାବଲେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ପତ୍ତନି ଏବଂ ସୂଚକ (ସାରଣୀ 4.9 ରେ)

ଡିସଟ୍ରୀବ୍ୟୁଟ୍/ ଡିସଟ୍ରୀବ୍ୟୁଟ୍	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟକ୍	ମେଟଫର୍ମିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ପରିମାଣ (500 ମିଗ୍ରା) (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)				
		ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ	ଯୋଗାଣ	ବ୍ୟବହୃତ	ଶେଷ ଷ୍ଟକ୍	ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 2020-21	1.87	17.00	39.88	9.04	32.71	9.93
ଭଦ୍ରକ 2020-21	1.88	12.47	40.73	6.05	36.56	0.23
ଭଦ୍ରକ 2021-22	36.56	13.71	2.41	12.09	26.88	23.37
<b>ମୋଟ</b>		<b>43.18</b>	<b>83.02</b>	<b>27.18</b>		<b>33.53</b>

(ଉତ୍ସ: ଡିସଟ୍ରୀବ୍ୟୁଟ୍, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଡିସଟ୍ରୀବ୍ୟୁଟ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ତଥ୍ୟ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ସମୟରେ, 29.47 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ପରିମାଣ ତୁଳନାରେ, ଦୁଇଟି ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ (ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ) ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହୋଇଥିବା, ଡିଡିଏଚ୍ଏଚ୍ 80.61 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କେବଳ 15.09 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି, ଓଏସ୍ଏମ୍ଏସିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପରିମାଣର 2.74 ଗୁଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ 36.56 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ 13.71 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିଥିଲେ । ଏହିପରି, ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅୟୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସହିତ ଅଧିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା ।

- ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ (ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼)ର ଦୁଇଟିରେ ସେଫ୍ଟିକ୍ସିଲ୍ 500 ମିଗ୍ରା ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ପାଇଁ ସୂଚନାକ୍ରମ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି । ସାରଣୀ 4.9 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବିଚାର ନକରି ଇଣ୍ଡେକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିଲେ ।

ସାରଣୀ 4.9: ସେଫ୍ଟିକ୍ସିଲ୍ 500 ମିଗ୍ରା ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସୂଚକ (ଲକ୍ଷରେ)

ଡିଡିଏଚ୍ଏଚ୍/ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷକ୍	ବ୍ୟବହୃତ ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷରେ)			ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଡି	ବ୍ୟବହୃତ	ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ
		2018-19	2019-20	2020-21			
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (2020-21)	2.91	8.11	10.05		20.00	5.07	1.33
ଭଦ୍ରକ (2021-22)	13.93		11.04	11.12	19.23	2.17	13.10

(ଉତ୍ସ: ଡିଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଏବଂ ଭ-ନିରାମୟ ତାଲିକାରେ ତଥ୍ୟ)

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 2020-21 ସମୟରେ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 20 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହି ମେଡିସିନିର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10.11 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଭଦ୍ରକ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସମୟରେ 19.23 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିଥିଲେ । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 7.24 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 14.43 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ସମୟସୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଶାଳ କ୍ଲୋଜିଂ ଷକ୍ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 36.07 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତୁଳନାରେ ଓଏସ୍ଏମ୍ଏସିଏଲ୍ ଠାରୁ କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 14.46 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ଏବଂ 4.45 ଲକ୍ଷ ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

- 2020 ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 10,100 ଯୁନିଟ୍ ଇନ୍ଦୋର୍ସିଭାଇଟ୍ ତାଲିକାରେ (5 ମିଗ୍ରା) ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ପାଇଁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ (2018-19 ଏବଂ 2019-20) 1000 ରୁ 2200 ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବାବଦରେ ଓଏସ୍ଏମ୍ଏସିଏଲ୍ 27,200 ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ଯୋଗାଇଲା, ଯାହା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପରିମାଣର 2.7 ଗୁଣ ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ଔଷଧର 20,400 ଯୁନିଟ୍ (ମୂଲ୍ୟ 673,672) ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କାରଣ କେବଳ 3,700 ଟାକ୍ସିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । ଏହିପରି ଅୟୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ କମ୍ ବ୍ୟବହାର, ଏହି ଜଟିଳ ଔଷଧର ବହୁ ପରିମାଣର ସମାପ୍ତି ଘଟାଇଲା (ଆର୍ଷି-ଆର୍ଜିନାଲ) ଯାହା ଛାଡି ଯିବାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।
- ପିଆରଏମ୍ ଏମ୍ଏସିଏଚ୍ 2020-21 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟୋର (ସିଡିଏସ୍), ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ 11 ପ୍ରକାର (11,99,620 ଯୁନିଟ୍) ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1,06,735 ଯୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 10,92,885



ସ୍କୁନିଟ୍, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 45.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା । ଏହି ଡ୍ରଗ୍ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ପିଆର୍ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଏହାର ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଜିଲ୍ଲା/ ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଡ୍ରଗ୍ ଯୋଗାଣ ଶୁଳ୍କକାର ଅନୁପସ୍ଥିତି/ ଅନୁପସ୍ଥିତ ମନିଟରିଂ ରହିଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଖନନ ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ/ ଜଟିଳ ଔଷଧର ସମୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

**4.1.6.1 ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନୋ-ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି (ଏନ୍‌ଏସ୍‌କ୍ୟୁ) ଡ୍ରଗ୍ସର ନିଷ୍ପାଦନ ନହେବା**

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରିଚାଳନା ନୀତି (2003)<sup>88</sup> ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ<sup>89</sup> ମୁଖ୍ୟମାନେ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ/ ନୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି (ଏନ୍‌ଏସ୍‌କ୍ୟୁ) ଡ୍ରଗ୍ସ ସମନ୍ୱୟ ଷ୍ଟକଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏସ୍‌କ୍ୟୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଦାମ ଏବଂ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ରେ ପଡ଼ିଛି କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଏନ୍‌ଏସ୍‌କ୍ୟୁ ଏବଂ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏହିପରି ଏନ୍‌ଏସ୍‌କ୍ୟୁ/ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକ୍ କେବଳ ଡିଡ୍ରାମ୍‌ସ୍‌ଏଚ୍/ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ।



ଏନ୍‌ଏସ୍‌କ୍ୟୁ ଏବଂ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ପିଆର୍ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ରେ ଡିଡ୍ରାମ୍‌ସ୍‌ଏଚ୍ରେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟରର ପାର୍ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ିତ (27 ଏପ୍ରିଲ 2022)

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକରେ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ସହିତ ସମାନ ଯାକ୍ତେ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ (10 ମଇ 2022)

ଯଦିଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.6) ରେ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ / ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରଣ ନକରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପରେ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

<sup>88</sup> ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ।  
<sup>89</sup> ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ/ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ/ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧୀକ୍ଷକ



## 4.2 ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର

ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ସାମ୍ବ୍ୟସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରୋଗୀର ସାମ୍ବ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ମାନକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସୁନିଶ୍ଚିତ ସାମ୍ବ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର (ଇଆଇଏଫ୍) ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାମ୍ବ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ୍ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପରି ସମାକ୍ଷା, ସାମ୍ବ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ଇଆଇଏଫ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଉପଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବକୁ ଦେଖିଲା ।

### 4.2.1 ଇଆଇଏଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଣ

ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା (ଡିସେମ୍ବର 2014) 'ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କ୍ରୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ପରିଚାଳନା (ଇଆଇଏଫ୍)' ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରିଚାଳନା ଯୁନିଟ୍(ଏସ୍‌ଟିଏମ୍‌ୟୁ) ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗୃହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏପିପିର ରୂପାନ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପରିଚାଳନାକମିଟି(ଏସ୍ ଇଏମ୍‌ସି) ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ତର ଏବଂ ବଜେଟ୍ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଣାଯିବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣକୁ ଏସ୍‌ଇଏମ୍‌ସି ରୂପାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଇଏମ୍‌ସି 5.21 ଲକ୍ଷ ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ବାବଦରେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ କେବଳ 3.11 ଲକ୍ଷ (60 ପ୍ରତିଶତ) ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟ କରିପାରିବ, ସାରଣୀ 4.10 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ 4.10: ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଇଆଇଏଫ୍ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ**

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ଇଆଇଏଫ୍ ଅଭିପ୍ରେରିତ/ ଅନୁମୋଦିତ	ଇଆଇଏଫ୍ ଯାହା ପାଇଁ ପିଓ ଗୁଡ଼ିକ	ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ	ଇଆଇଏଫ୍ ସ୍ଥାପିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟ/ ଯୋଗାଣ ନହେବା
2016-17	32,423	21,631	20,158	20,158	1,473
2017-18	41,759	3,283	3,196	3,196	87
2018-19	65,000	35,320	25,159	25,159	10,161
2019-20	1,14,650	86,864	75,648	75,648	11,216
2020-21	1,32,435	1,00,387	92,177	92,177	8,210
2021-22	1,34,461	1,30,679	94,218	94,218	36,461
ମୋଟ	5,20,728	3,78,164	3,10,556	3,10,556	67,608

(ଉତ୍ସ: ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଉପରୋକ୍ତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଏସ୍‌ଇଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଇଆଇଏଫ୍ 60 ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । 2016—22 ମଧ୍ୟରେ 3,78,164 ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍, କ୍ରୟ ଅର୍ଡର (ପିଓ) ରଖିଥିଲା, ଯାହା ବାବଦରେ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ କେବଳ 3,10,556 (82 ପ୍ରତିଶତ) ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣର କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତରରେ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ କହିଛନ୍ତି (ଅକ୍ଟୋବର 2022) ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗାଣ ନହେବା କାରଣ ପଚରାଯିବା, ଯାହା ପାଇବା ପରେ, ପିଓର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ତାହାର ମାନ/ ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରାହକ ରସିଦ୍ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସିଆର୍‌ଏସ୍) ଉପରେ ଆଧାର କରି ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଦେୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ କମିଶନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକ ପ୍ୟାକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯଦିଓ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।

ଏହା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଫଳତା/ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ପିଓର ସର୍ଭିଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପକରଣର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ମୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେୟଗୁଡ଼ିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲା ।

ସାମ୍ପ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତତା ପାଇବା ପରେ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

**4.2.2 ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା**

ସାମ୍ପ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଡାକ୍ତରଖାନା (ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍/ ସିଏଚ୍‌ସି/ପିଏଚ୍‌ସି) ପାଇଁ ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଆଦର୍ଶ ତୁଳନାରେ ସାତଟି ନମୁନା ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଭାବ ରହିଛି । ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବର୍ଗ/ ସେବା ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧତାର ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 4.11 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ 4.11: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା**

ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉପକରଣ	ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତାର ପ୍ରତିଶତ						
	ଉତ୍ତୁକ (336)	ଡେକାନାଲ (300)	କକ୍ଷମାଳ (236)	ନବରଙ୍ଗପୁର (252)	ନୂଆପଡ଼ା (315)	ପୁରୀ (451)	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (330)
ଓଟି	54	50	83	54	54	65	73
ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ	0	0	0	29	0	29	29
ଇମ୍ପୁନଜାଇଶନ	73	80	73	60	73	60	80
କାର୍ଡିଓପୁଲ୍ମୋନାରୀ	80	57	50	29	53	100	80
ଇଏନ୍‌ଟି	0	11	11	44	28	39	39
ଲେବର, ନିଅନାଗାଲ ଏବଂ ଏସଏନସିୟୁ	63	52	70	41	78	52	74
ଇମେଜିଙ୍ଗ ଉପକରଣ	71	83	67	83	43	29	57
ଏକ୍ସ-ରେ ଆସେସୋରିଜ୍	75	63	88	88	50	75	63
ଟକ୍ସୁ	84	71	71	79	80	76	96
ଦାନ୍ତ	91	53	38	82	44	56	26
ପରୀକ୍ଷାଗାର	37	32	30	30	38	37	33
ସର୍ଜିକାଲ୍	11	23	21	47	9	23	26
ଆନେସ୍ଥେସିଆ	59	36	50	68	55	59	36
ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ୍	13	75	75	50	13	38	63

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ରୁ ଉଧ୍ୟ)

(ଉତ୍ସ: ହନିଦିଆ ରଙ୍ଗ; ଉପଲବ୍ଧତା ନାହିଁ: 50 ପ୍ରତିଶତ ରୁ କମ୍ ଉପଲବ୍ଧତା; ସବୁଜ: 50 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧତା)

ଉପରୋକ୍ତରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ନମୁନା ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇନଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣର ଅଭାବ ସହିତ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ନବରଙ୍ଗପୁରର 47 ପ୍ରତିଶତରୁ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ 57 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେକାନାଲ ।

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ କେତେକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

**4.2.2.1 ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ର ଓଟି ରେ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା**

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ 24 ରୁ 26 ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକ ତୁଳନାରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ର ଓଟିରେ କେବଳ 12 ରୁ 20 ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ । ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଟି ରେ କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା ସାରଣୀ 4.12 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.12: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା

କ୍ର. ସଂ.	ଉପକରଣ	ଉପକରଣର ଉପଯୋଗିତା	ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା
1	ଓଡ଼ି ସାରଣୀ (ଶିଶୁ)	ସର୍ଜିକାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଶିଶୁ ରୋଗୀମାନେ ଏକ ଓଡ଼ି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି	ଦେଙ୍କାନାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
2.	ଓଡ଼ି ସାରଣୀ (ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍)	ସର୍ଜିକାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଆର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପରେଟିଂ ସାରଣୀ, ବେଳେବେଳେ ଅପରେଟିଂ ରୁମ୍ ଟେବୁଲ୍ କୁହାଯାଏ	ଦେଙ୍କାନାଳ, ଏବଂ ପୁରୀ
3.	ଡି ହୁମିଡ଼ିଫାୟର	ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ	ଦେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ପୁରୀ
4.	ଅଲୁମିନିୟମ୍ ଡାଏ	ରୋଗୀ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ରୁମ୍ କୁ ଡିଜେନିଫାଇଁ କରିବା ପାଇଁ	ଭଦ୍ରକ, ଦେଙ୍କାନାଳ, କାନ୍ଧାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
5.	ଇଥ୍ରଲିନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର	(ଇଓ କିମ୍ବା ଇଡିଓ) ଗ୍ୟାସ୍ ୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ସି ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ / କିମ୍ବା ବିକିରଣ ଯେପରିକି ପ୍ଲାସ୍ମା, ଅଲ୍ଟ୍ରା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରି ବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ	ଭଦ୍ରକ, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
6.	ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର (ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର)	ପ୍ରାୟ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ 121°C ରେ ଉଚ୍ଚ ତାପରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବାଷ୍ପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଯୋଗାଣକୁ ନିର୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।	ଦେଙ୍କାନାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀ

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ ଏବଂ ଜେପିଆଇର ତଥ୍ୟରୁ )

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ ନିଅଣ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଆଇପିଏଚ୍-ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପକରଣର ବାସ୍ତବିକ ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

**4.2.2.2 ଲାବୋରେଟୋରୀ ସେବାରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧତା**

ଜିଲ୍ଲା ତାତ୍ତ୍ୱଗଣାନା<sup>90</sup>ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଇଁ ଆଇପିଏଚ୍-ଏସ୍ 60ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉପକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ । ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆଇପିଏଚ୍-ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପକରଣର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କେବଳ 30 ରୁ 38 ପ୍ରତିଶତ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ସାରଣୀ 4.13 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.13: ନିଶ୍ଚିତ ଉପକରଣ

ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍	ନିଶ୍ଚିତ ଉପକରଣ	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କେବେଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ	ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର କାରଣ
ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ	ଗୋଟିଏ 5- ଅଂଶ ସିବିଟି ମେସିନ୍	7.48	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ନହେବା ଯଦିଓ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଓ୍ଵାରେଣ୍ଟି ଅଧିନରେ ଥିଲା
	ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ		ଏପ୍ରିଲ 2021	
ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍, ଦେଙ୍କାନାଳ	ହେମାଟୋଲୋଜି ଆନାଲାଇଜର (5 ଅଂଶ)	8.83	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020	ରେଜେକ୍ସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
	ଅଟୋ ଆନାଲାଇଜର	20.59	ନଭେମ୍ବର 2020	

<sup>90</sup> 100 ରୁ 300 ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ତାତ୍ତ୍ୱଗଣାନା

	ବାୟୋ ନିରାପତ୍ତା କ୍ୟାବିନେଟ୍	2.26	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020	ଅଧିକ ଯୋଗାଣ
ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ନବରଙ୍ଗପୁର	ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବିଶ୍ଳେଷକ	20.59	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	ରେଜେଣ୍ଡର୍ ଅଭାବ
	ସିବିସି ମେସିନ୍ (5 ଅଂଶ)	7.35	2013	ରେଜେଣ୍ଡର୍ ଅଭାବ

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଉତ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଜେପିଆଇଇ ନିଅର୍ଭୁ)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

**4.2.2.3 ମାଡ୍ରୁଡ୍ ଶାଖାରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଭାବ**

ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ପ୍ରସୂତା ଡ୍ୱାର୍ଡ୍ ପାଇଁ ତଥା ନବଜାତକ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଯୁନିଟ୍ ପାଇଁ 28 ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ । ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସୂତା ବିଭାଗରେ 8 ରୁ 17 ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ସର୍ବାଧିକ ଅଭାବ (61 ପ୍ରତିଶତ) ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଦେଖାଗଲା, ତା’ପରେ ପୁରୀର ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ (50 ପ୍ରତିଶତ), ଡେଙ୍କାନାଳ (39 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ଭଦ୍ରକ (36 ପ୍ରତିଶତ) ଦେଖାଗଲା । ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଜଟିଳ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧତା ନ ହେବା **ସାରଣୀ 4.14** ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ 4.14: ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମାଡ୍ରୁଡ୍ ଡ୍ୱିଙ୍ଗ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଭାବ**

ଉପକରଣ	ଉପକରଣର ଉପଯୋଗିତା	ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା
ବେବି ଇନ୍‌କ୍ୟୁବେଟର	ଏକ ବେଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଯୁନିଟ୍, ଏକ ଆବରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ, ଅକାଳ ଶିଶୁ/ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।	ଭଦ୍ରକ, ଡେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
ଫଟୋଥେରାପି ଯୁନିଟ୍	ହାଇପରବିଲିଗୁବିନେମିଆର ଚିକିତ୍ସା/ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ (ଉଚ୍ଚତର ସେରମ୍ ବିଲିଗୁବିନ୍ ସର)	ଭଦ୍ରକ, ଡେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର
ଡବଲ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍‌ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର	ପରିବେଶ ବାୟୁରୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ଅମ୍ଳଜାନ ବିତରଣ କରିବା	ଭଦ୍ରକ, ଡେଙ୍କାନାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର
ଫୋଟଲ ଡପ୍ପର	ଅଲୁସାଇଡ୍ରା/ ଡୋପଲର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍, ହାତ ଧରିଥିବା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଡିଭାଇସ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଭ୍ରୂଣର ହୃଦ୍‌ଘାତକୁ ଅଣ-ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ	ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ
କାର୍ଡିଓ ଗାଜୋଗ୍ରାଫି ମନିଟର	ମାତାର ପେଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଲୁସାଇଡ୍ରା ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଭ୍ରୂଣର ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟ ସଂକୋଚନକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହିଏ	ଭଦ୍ରକ, ଡେଙ୍କାନାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀ
ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ମେଟାଲ	ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବିତରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହିଏ	ସମସ୍ତ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍
ବେବି ନେରୁଲାଇଜର	ଏରୋସୋଲାଇଜର୍ ଔଷଧ/ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଉପକରଣ, ଯାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ	ଡେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା
ସିପିଏପି ମେସିନ୍	ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଣ-ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହାୟତା (ସିପିଏପି) ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ	ସବୁ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକକୁ ଛାଡ଼ି

(ଉତ୍ସ: ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଏବଂ ଜେପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଆଇପିଏଚ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଆନୁଯାୟୀ ମାତୃତ୍ୱ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

**4.2.2.4 ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍**

ଆଇପିଏଚ୍ ଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ନବଜାତକ ଏବଂ ସତରଞ୍ଜ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ଧି (ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍) ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଯତ୍ନ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟତାର ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 4.15 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

**ସାରଣୀ 4.15: ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟତା**

କ୍ର. ସଂ.	ଉପକରଣ ନାମ	ଉପକରଣର ଉପଯୋଗିତା	ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ
1	ବେବି ଇନ୍-କ୍ୟୁବେଟର	ବାକ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଚାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଅକାଳ ଶିଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ଚାପମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ	ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ
2	ବେବି ନେକୁଲାଇଜର	ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ତରଳ ଔଷଧକୁ କୁହୁଡ଼ିରେ ପରିଣତ କରେ, ଯାହା ଶିଶୁର ବାୟୁପଥରେ ଫୁଲ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, କାଶ ଏବଂ ଚକ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ	ସମସ୍ତ ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍ରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ
3	ରେଡିଏଣ୍ଟ ବାରମର	ଏକ ଉତ୍ତମ ଗରମ ଉତ୍ତ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଚାଳିତ ଉପକରଣ, ଏକ ଶିଶୁର ଚାପକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ	ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍, କନ୍ଧମାଳରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ
4	ଫୋଟଲ୍ ଡିପୁର	ଏକ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଡ଼ରର ପ୍ରସବ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଭୁଣର ହୃଦୟାଠକ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ	ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ
5	ବବଲ୍ ସିପିଏପି କମ୍ପ୍ରେସର ସହ	ଏକ ଅଣ-ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମର୍ଥନ ମୋଡାଲି, ଯାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ସହିତ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ	ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ
6	ପୋଟେବଲ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ମେସିନ୍	ମୋବାଇଲ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ସିଷ୍ଟମ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟିନ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ	ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ
7	ହେମୋଗ୍ଲୁବିନ୍ ମିଟର	ସ୍ୱେକ୍ଟପୋମୋମେଟ୍ରିକ୍ ମାପ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଉପକରଣ	ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍, ପୁରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ
8	ସକ୍ୱନ ମେସିନ୍	ରୋଗୀର ବାୟୁପଥ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ପଦାର୍ଥକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାକୁ	ସମସ୍ତ ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍ରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ
9	ଗୁକୋମିଟର	ରକ୍ତରେ ଗୁକୋଜ୍ (ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନି) ସ୍ତର ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଛୋଟ, ପୋଟେବଲ୍ ମେସିନ୍	ସମସ୍ତ ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍ରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ
10	ଫଟୋଥେରାପି (ବୁଲ୍ ଲାଇଟ୍)	ଇଲିଗୁବିନର ଏକାଗ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏକ ଉପକରଣ	ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ
11	ନିଉନାଗାଲ୍ ରିସେକ୍ସନ୍ କାଟ	ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆସଫିକ୍ସିଆରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ	ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ କେମିଆଇ ଗୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଶିଶୁ ଇନ୍-କ୍ୟୁବେଟର ଏବଂ ସି-ପିଏପି ମେସିନ୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ତିନୋଟି ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ (ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼) ରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍ (କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର) ରେ କୌଣସି ନବଜାତକ ରିସେକ୍ସନ୍ କିଟ୍ ନାହିଁ । ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍, କନ୍ଧମାଳରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟତା ଥିବାରୁ ନବଜାତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ (ରେଡିଓଲୋଜି/ ପାଥୋଲୋଜି ବିଭାଗ) କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚ ସୁବିଧାକୁ ଯୋଗାଉଥିଲା ।



ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ( ଏପ୍ରିଲ 2022) ଯେ 12 ଟି ଉତ୍କଳ ଉଷ୍ମତା (ମୂଲ୍ୟ: 3.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ତିନିଟି ଫୋଟୋଥେରାପି ଯୁନିଟ୍ (ମୂଲ୍ୟ: 1.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ଭଦ୍ରକର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ରେ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମାନବସମ୍ବଳର ଅଭାବ (ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସ) ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଫୋଟୋଥେରାପି ଯୁନିଟ୍‌ରେ ତିନୋଟି ନବଜାତକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନପାତି ଗ୍ରହଣ ହେଉ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ।



ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ (କ୍ଷେପ୍ ଡାଉନ୍ ୱାର୍ଡ) ରେ ଗୋଟିଏ ଫୋଟୋଥେରାପି ଯୁନିଟ୍‌ରେ ତିନୋଟି ନବଜାତକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି (ଏପ୍ରିଲ 2022)

ସାମ୍ପ୍ରାୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯତ୍ନପାତି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ କ୍ରୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

**4.2.2.5 ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଉପକରଣର ଅଭାବ**

ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଯତ୍ନପାତି, ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ନକରି, ସାତୋଟି ପରୀକ୍ଷିତ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ କେବଳ ତିନୋଟି ଉପଲବ୍ଧ । ଯଦିଓ, ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଯତ୍ନପାତି ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା । ଦୁଇଟି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍ (ପୁରୀ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର)ରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା, କାରଣ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ହେତୁ ଏହି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଉପକରଣ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

**4.2.2.6 ଇଏନ୍‌ଟି ଉପକରଣର ଅଭାବ**

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍, ଭଦ୍ରକର ଇଏନ୍‌ଟି କ୍ଲିନିକରେ ଇଏନ୍‌ଟି ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଇଏନ୍‌ଟି ପରୀକ୍ଷା ସେଟ୍ ଏବଂ ଆଠଟି ଇଏନ୍‌ଟି ହେଡ଼ଲାଲର୍ କର୍ଣ୍ଣ, ଇଏନ୍‌ଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଏନ୍‌ଟି ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିବା ସର୍ ଷ୍ଟୋରରେ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଇଏନ୍‌ଟି ଯତ୍ନପାତି ଯୋଗାଣର କାରଣ, ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଅଧିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପକରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଯତ୍ନପାତି ଗୁଡ଼ିକର ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ / ନିଷ୍ପିନ୍ଧତା ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଅପାରଗତା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।

**4.2.2.7 ରକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯତ୍ନପାତିର ଅଭାବ**

ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ କସମେଟିକ୍ ନିୟମ 1945 ଅନୁଯାୟୀ, ରକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ 22 ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ<sup>91</sup> ଏବଂ ଯତ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ସମାକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସିରେ ଯତ୍ନପାତି ଏବଂ ଯତ୍ନର ଅଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ଗୁ ସାତୋଟି ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା । କେତେକ ଯତ୍ନପାତିର ଆଇଟମ୍, ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ନିମ୍ନରା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

<sup>91</sup> ଭଦ୍ରକ:3; ଡେଙ୍କାନାଳ:3; କନ୍ଧମାଳ:2; ନବରଙ୍ଗପୁର:4; ନୂଆପଡ଼ା:0; ପୁରୀ:7; ସୁନ୍ଦରଗଡ଼:1

- ସ୍ଥାନୀୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରର ସହଜ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଅର୍ଥରତ୍ନ ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ (ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼)ର ବିସିରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ପରୀକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଚିକିତ୍ସା ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍ (ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ପୁରୀ)ର ଏହି ବିସିରେ ସେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡ୍ରାଟର ସ୍ଥାନ/ ସେରୋଲୋଜିକ୍ ରୋଟେଟର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ରକ୍ତ ଦାତା କୋଚ, ଯାହା ରକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ସହଜଏବଂ ନିରାପଦ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ବିସି ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍, ପୁରୀ ବିସିରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଯତ୍ନପାତ୍ର ଅଭାବ/ ଉପଲବ୍ଧତା ରକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ବିସିମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

### 4.2.3 ସିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍ ରେ ଉପକରଣର ଅଭାବ

ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନଅ ବର୍ଗର ସେବା ଅଧିକରେ ସିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍ରେ 51 ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ୍ । ସମୀକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ନୁହଁନ୍ତି, ଯେପରି<sup>92</sup> ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ଦୁଇଟି ସିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍ (ବାରିପଦା ଏବଂ ଖରିଆର ରୋଡ଼) ରେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ସେକ୍ଟର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ବେଳେ ସାତଟି<sup>93</sup> ସିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍ରେ କୌଣସି ଆନାସ୍ତେସିଆ ଉପକରଣ ନଥିଲା ।
- ପରୀକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ସିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟିରେ<sup>94</sup> ରେଡିଓଲୋଜି<sup>95</sup> ଉପକରଣ ନଥିଲା ଏବଂ ତିନୋଟି ସିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍ରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବିଧ ଉପକରଣ ନଥିଲା ।
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2021 ମଧ୍ୟରେ ସିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍, କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ ଉପକରଣ ଦାତ୍ର ଚେୟାର ଏବଂ ଡେସ୍କାଲ ଏକ୍ସ-ରେ ମେସିନ୍, ଦ୍ରବ ଚିକିତ୍ସକ ପୋଷ୍ଟ ନହେବା କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ।
- ପରୀକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ସିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମାତୃତ୍ୱ ଡିଭିଜନରେ 27 ର ଆବଶ୍ୟକତା ଭୁଲନାରେ କେବଳ 11 ରୁ 22 ଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ସି-ପିଏପି ମେସିନ୍, କାର୍ଡିଓ-ଗୋକୋଗ୍ରାଫି ମନିଟରିଂ, କାର୍ଡିଆକ୍ ମନିଟରିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ଲାବୋରେଟୋରୀ ସେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନପାତ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 2020 ପରଠାରୁ ଯତ୍ନପାତ୍ର (ସେମି ଅଗୋ ଆନାଲିଜର ଏକ୍ସିଡି 2020) ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା କାରଣରୁ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧିକରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚୋଟି<sup>96</sup> ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ନଥିଲା, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ।

<sup>92</sup> (i) ସର୍ଜିକାଲ୍ ସେକ୍ଟର (ii) ଆନାସ୍ତେସିଆ ପାଇଁ ଉପକରଣ (iii) ନବ ନାଟାଲ୍ ପୁନର୍ଗଠନ (iv) ଓଟି (v) ରାଡିଓଲୋଜି (vi) ପ୍ରତିରୋପଣ (vii) ଲେବର ରୁମ୍ (viii) ଲାବୋରେଟୋରୀ (ix) ବିବିଧ

<sup>93</sup> ବାରିପଦା, ବାସୁଦେବପୁର, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା, ରାଇକିଆ, ଚିକାବାଲ୍ ଏବଂ କୋମନା

<sup>94</sup> ବାରିପଦା, ଖଜୁରିଆକଟା, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ରାଇକିଆ, ଖରିଆର ରୋଡ଼, କୋମନା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବାଙ୍ଗୁରିଗାଁ


<sup>95</sup> ବାରିପଦା, କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଲହୁଣୀପଡ଼ା

<sup>96</sup> (i) ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର (ii) ବ୍ଲଡ୍ ସ୍କ୍ରିମିଆ/ ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟରଲ (iii) ଯକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା (iv) କିଡନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷା (v) ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍

ହେମାଟୋଲୋଜି ଅଧିକାରୀ<sup>97</sup> ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚାରିଟି<sup>98</sup> ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ପରୀକ୍ଷା ସିଏଚ୍ସି, ବାରିପଦା ଠାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ ସିବିସି ଫେସିନ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ହେତୁ ସେହି ଫେସିନ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁନଥିଲା ।

- ଏକ ସିଏଚ୍ସିର ଓଟି ରୁମ୍ରେ 13ଟି ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ୍ । ସମୀକ୍ଷା ନଅଟି ପ୍ରମୁଖ ଯନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ:
  - ସିଏଚ୍ସି, ବରପଦା ଓଟି ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପକରଣ ନଥିଲା ।
  - ସମସ୍ତ 13 ସିଏଚ୍ସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରେସନ ଟେବୁଲ୍ (ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍) ପ୍ରମୁଖ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଥିଲା ।
  - ସିଏଚ୍ସି, ଖରିଆର ରୋଡ୍ରେ ଏକ ଓଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଛାୟାହୀନ ପ୍ରଦୀପ (ଡାଇନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛାୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ) ଓଟିରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
  - ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଡାଇଥର୍ମି ଫେସିନ୍, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଟିସୁ ଭିତରେ ଗଭୀର, ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 11 ଟି ସିଏଚ୍ସିରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ବାସୁଦେବପୁର, ଚିକାବାଲି ଏବଂ ନିମାପଡ଼ାର ସିଏଚ୍ସିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।

ନଅ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାରର ଓଟି ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା ଚାର୍ଟ 4.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

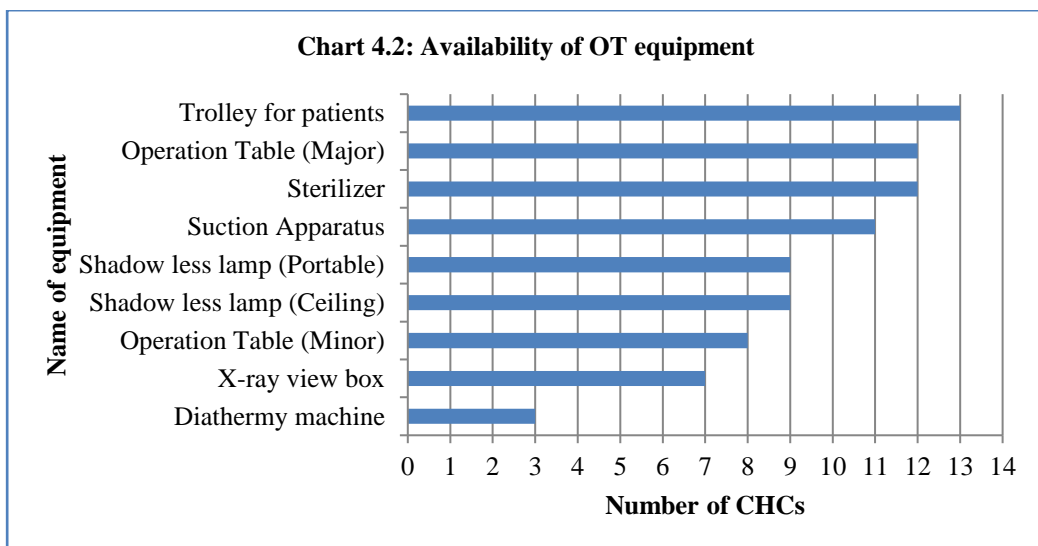

(ଉତ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସିଏଚ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି)

ଏହିପରି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସିଏଚ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ଅଭାବ ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ ସୁବିଧା ଥିବା ଅନ୍ୟ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଆଇପିଏଚ୍ସିଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏଚ୍ସିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

<sup>97</sup> (i) ସମୁଦାୟ ଲ୍ୟୁକୋସାଇଟ୍ ଗଣନା (ii) ମୋଟ ଆରବିସି ଗଣନା (iii) ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଗଣନା (iv) ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା କୋଷ ପରିମାଣ

<sup>98</sup> 5ରୁ ଯୁଗିଆ/ ରକ୍ତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ (ii) ଯକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା (iii) କିଡନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷା (iv) ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍

### 4.2.3.1 ସିଏଚ୍‌ସି ରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା

ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ରକ୍ତ ସ୍ତୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଏଚ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ:

- 14 ଟି ପରୀକ୍ଷିତ ସିଏଚ୍‌ସି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚୋଟି ସିଏଚ୍‌ସିରେରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ତୁନିଟ୍‌ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ସିଏଚ୍‌ସି ମଧ୍ୟରୁକେବଳଦୁଇଟି ସିଏଚ୍‌ସି (ନିମାପଡ଼ା ଏବଂ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା)ରେ ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ତୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ।
- ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ପରି ଆବଶ୍ୟକ ମାନବସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ସିଏଚ୍‌ସି (ବାସୁଦେବପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମଣାପଡ଼ା, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି)ରେ ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ତୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ସିଏଚ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ତୁନିଟ୍ ନିଷ୍ପନ୍ନ ରହିଲା ।
- ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନଅଟି ସିଏଚ୍‌ସିର ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ତୁନିଟ୍ ନଥିଲା ।



ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଫରାଜେରଡୋର ସିଏଚ୍‌ସି, ବାସୁଦେବପୁରରେ ମଇ ୨୦୧୯ରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା (27 ଏପ୍ରିଲ 2022)

ସିଏଚ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ତୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା /ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ, ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧା ଥିବା (ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍/ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍)କୁ ପଠାଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ନିଜେ ରକ୍ତ ସ୍ତୁନିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇତ୍ୟାଦି ଅଭାବରୁ ଏହା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

### 4.2.4 ପିଏଚ୍‌ସି ରେ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା

ସମୀକ୍ଷା 30 ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଅଧିନରେ ପିଏଚ୍‌ସି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ 14ଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପିଏଚ୍‌ସି ମଧ୍ୟରୁ<sup>99</sup> କୌଣସିଟିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପିଏଚ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା 7 ରୁ 24 ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । 14 ଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପିଏଚ୍‌ସି ମଧ୍ୟରୁ<sup>100</sup> ଆଠଟିରେ ସାଧାରଣ ବିତରଣ କିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ବେଳେ ପାଞ୍ଚୋଟି ପିଏଚ୍‌ସିରେ କୌଣସି କ୍ୟାଲୋରିମିଟର ଏବଂ ହାଲୁକା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା ।

ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ବାଇନୋକୁଲାର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍, ପିଏଚ୍‌ସି, ଏରଡାଲ ଏବଂ ସାବରଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଥିଲା ।

<sup>99</sup> ସାବରଙ୍ଗ, ଏରଡାଲ, ରାସୋଲ, ଅଣ୍ଡାଳି କାମବାହାଲ, ରଞ୍ଜାବରାଡି, ଦର୍ଲିମୁଣ୍ଡା, ଫକିରସାହି  
<sup>100</sup> ସାବରଙ୍ଗ, ଏରଡାଲ, ଯୋରନ୍ଦା, ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼, ଚାରବୋଦ

ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଆଇପିଏସ୍‌ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏସ୍‌ସିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

**4.2.5 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା**

ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକର 13ଟି କ୍ଲିନିକାଲ ବିଭାଗରେ 628 ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଅତିତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍ ମାନଦଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ 13 ଟି କ୍ଲିନିକାଲ ବିଭାଗରେ, ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏସ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ।

**4.2.5.1 କ୍ଲିନିକାଲ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ**

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ସି ମାନଦଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ସାରଣୀ 4.16 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ନମୁନା ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏସ୍‌ର 13 ଟି କ୍ଲିନିକାଲ ବିଭାଗରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଭାବ ରହିଛି ।

**ସାରଣୀ 4.16: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉପକରଣ**

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗ	ଆବଶ୍ୟକ	ପିଆର୍ ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏସ୍‌ରେ ଉପକରଣର ପ୍ରକାର		ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏସ୍‌ରେ ଉପକରଣର ପ୍ରକାର	
			ଉପଲବ୍ଧ	ଅଭାବ (ପ୍ରତିଶତ)	ଉପଲବ୍ଧ	ଅଭାବ (ପ୍ରତିଶତ)
1	ଔଷଧ	53	21	32 (60)	20	33 (62)
2	ପେଡିରେଟ୍ରିକ୍	49	31	18 (37)	44	5 (10)
3	ଟିବି ଏବଂ ଛାତି	13	7	6 (46)	8	5 (38)
4	ଚର୍ମ ଏବଂ ଭିଡି	8	1	7 (88)	4	4 (50)
5	ମାନସିକ	13	4	9 (69)	7	6 (46)
6	ଶଲ୍ୟ	42	21	21 (50)	18	24 (57)
7	ଅପୋପେଡିକ୍	25	11	14 (56)	17	8 (32)
8	ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା	39	26	13 (33)	30	9 (23)
9	ଇଏନ୍ ଟି	178	130	48 (27)	153	25 (14)
10	ଓ ଏଣ୍ଡ ଜି	97	58	39 (40)	64	33 (34)
11	ଆନାସ୍ତେସିଓଲୋଜି	51	18	33 (65)	31	20 (39)
12	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଢୁଆଲିଟି	50	44	6 (12)	44	6 (12)
13	ରାଡିଓଲୋଜି	10	8	2 (20)	10	0 (0)

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

- ଉଭୟ ଏମ୍‌ସିଏସ୍‌ର ଔଷଧ (60ରୁ 62 ପ୍ରତିଶତ), କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଡି (50 ରୁ 88 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ସର୍ଜରୀ (50 ରୁ 57 ପ୍ରତିଶତ) ବିଭାଗରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସର୍ବାଧିକ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ।
  - ହୃଦ୍‌ଘାତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଇକୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫି ଉପକରଣ, ଡାକ୍ତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଫଳତା ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଇନଭେସିଭ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର; ଅମ୍ଳଜାନ ମାପିବା ପାଇଁ ଧମନୀ ରକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ (ଏବିଜି) ବିଶ୍ଳେଷକ । କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
  - ଉଭୟ ଏମ୍‌ସିଏସ୍‌ର ଚର୍ମ ଏବଂ ଭିଡି ବିଭାଗ, ଅସାଧାରଣ ଚିସୁ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ କ୍ରିଓଥେରାପି ଭଳି ଉପକରଣର ଅଭାବ; ହାଇପରହିଡ୍ରୋସିସ୍ ବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଇସୋଫୋରେସିସ୍ ମେସିନ୍ ।



- ସିଷ୍ଟେମ୍‌ସ୍‌ସ୍ୱାପ୍ ଏବଂ ରେଜେକ୍ଟ୍‌ସ୍ୱାପ୍ ପରି ଯତ୍ନପାତ୍ରି, ମୃତ୍ୟୁନଳୀରୁ ଚିପ୍ସ ଖୋଜିବା ଏବଂ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ; ପେଟର ପାକସୁଳୀ ସମସ୍ୟା ନିରାକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଭିଡିଓ କଲୋନୋସ୍କୋପି; ଇଣ୍ଟ୍ରା-ଅପରେଟିଭ୍ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସି-ବାହୁ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ଉଭୟ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ଜେନେରାଲ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

**4.2.5.2 ଅଣ-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ**

ଆଠଟି ଅଣ-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ଆର 469 ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ । ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଣ-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍/ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ଆଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶକରେ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ଆର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇନଥିଲା । 469 ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଉଭୟ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ଆଠଟି ଅଣ-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିଭାଗରେ କେବଳ 226 ରୁ 258 ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ମାଇକ୍ରୋ-ବାୟୋଲୋଜି, ଫୋରେନସିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଚକ୍ରିକୋଲୋଜି, କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ।

- ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟିବିଓଡି, ଲିମ୍ଫୋମା ପ୍ୟାନେଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିର କ୍ରମାଗତ ଯୋଗାଣ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳିତ ଇମ୍ୟୁନ-ହିଷ୍ଟୋ-ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସେକ୍ସନ୍ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କର୍ଜର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳିତ ନମନାୟ କଭର-ସ୍ଲିପିଂ ଡ୍ରାକ୍ଟ୍‌ସ୍‌ସେଟ୍, ଚିପ୍ସ କାଟିବା ଏମେଡିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଉଭୟ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ପାଥୋଲୋଜି ବିଭାଗ ।
- ପିଆରଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ସେକ୍ସିଫ୍ଲୁଗ୍, ଇନ୍‌ଫ୍ରା-ରେଡ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି, ଚିପ୍ସ ଫ୍ଲୋଟେସନ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରାଟର ସ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ଫୋରେନସିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଚକ୍ରିକୋଲୋଜି (ଏଫ୍‌ଏଫ୍‌ଟି) ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ସମାନ ବିଭାଗରେ, ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ, ଏକ ସମ୍ବଳିତ ଚିପ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଚିପ୍ସ ବାଇନୋକୁଲାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗଭୀର ଫ୍ଲିଜର ଇତ୍ୟାଦି ଅଭାବ ।
- ବାରୋମିଟର, କ୍ଲୋରୋସ୍କୋପି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ସହିପରି, ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏବଂ ଅଣ-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା/ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇନଥିଲେ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

**4.2.5.3 ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ଓପିଡିରେ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା**

ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିଭାଗର ଓପିଡି ପାଇଁ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ଆର ଉପକରଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଚାରୋଟି ବିଭାଗର ଓପିଡି (ଇଏନଟି, ସର୍ଜରୀ, ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ) ରେ ଉପକରଣ/ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସମୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଯାତ୍ରା କଲା ।

ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ଆର ଅଧିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦା କେବଳ 80 (48 ପ୍ରତିଶତ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାମଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସାରଣୀ 4.17 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 101 (49 ପ୍ରତିଶତ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।

ସାରଣୀ 4.17: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉପକରଣ

କ୍ର. ସଂ.	ଓପିଡି	ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧତା		ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧତା	
		ଆବଶ୍ୟକ	ଉପଲବ୍ଧ (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ)	ଆବଶ୍ୟକ	ଉପଲବ୍ଧ (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ)
1	ଇଏନଟି	49	43	49	45
2	ଶିଳ୍ପ	30	06	40	11
3	ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା	42	29	72	41
4	ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ	46	2	46	4
	ମୋଟ	167	80	207	101

(ଉତ୍ସ: ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

- ମଧ୍ୟମ କାନ ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତମାନର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନାସାଲ୍ ଓଟୋଷ୍କୋପ୍ ପରି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟମ୍, ନାସାଲ୍ ମକୋସା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ନାସାଲ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍, କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଲାରିନକ୍ସ, ଭଏସ୍ ବକ୍ସ ଏବଂ ଭୋକାଲ୍ କର୍ଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ, ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ଇଏନଟି ଓପିଡିରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ରକ୍ତମ୍ ଏବଂ ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ସମସ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋକ୍ଟୋସ୍କୋପ୍ ପରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ସର୍ଜିକା ଓପିଡିରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ଭିଜୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ଡର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଓପିଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଯୋଗିତ ପେରିମିଟର ପରି ଉପକରଣର ଅଭାବ ଥିଲା, ସିନୋପ୍ଟୋମେଟର, ବିଷ୍ମିଟି ଏବଂ ବାଲନୋକୁଲାରଦର୍ଶନର କୋଣ ଆକଳନ କରିବାକୁ, ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିପ୍ଲୋପିୟା (ଡବଲ୍ ଭିଜନ) ଇତ୍ୟାଦିର ଲକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡକ୍ସ ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ।
- ସେହିପରି, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ଓପିଡି ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ରେଫ୍ରେକ୍ସ ହାତୁଡ଼ି ନଥିଲା, ଗଭୀର ଟେଣ୍ଡନ୍ ରିଫ୍ରେକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପେରିଫେରାଲ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାୟଂ ପ୍ରଶାଳୀ ଏବଂ ଗୋନିଓମିଟର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୋଣ ମାପିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ ବସ୍ତୁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୂର୍ଭିନକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ।

ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ଓପିଡିରେ ଏହିପରି ମୌଳିକ ଉପକରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମୀକ୍ଷା ଓପିଡିରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତତା ଆଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।

ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଏମ୍‌ଏମ୍‌ସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ଓପିଡିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

#### 4.2.5.4 ଓଟି ରେ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା

ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଆର୍‌ରେ ଓଟି ପାଇଁ ଉପକରଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଆର୍‌ଆର୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପକରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର, ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ସାରଣୀ 4.18 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.18: ନମୁନା ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା

ବିଭାଗ / ଓଡ଼ି	ପିଆର୍ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ (100 ଆଡମିଶନ ପାଇଁ)		ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ (250 ଆଡମିଶନ ପାଇଁ)	
	ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ସଂଖ୍ୟା	ଅଭାବ	ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ସଂଖ୍ୟା	ଅଭାବ
ଓ ଏଣ୍ଡ ଜି	55	17	82	41
ଶଲ୍ୟ	110	79	163	129
ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା	20	12	37	26
ଇଏନ୍‌ଟି	215	70	215	64
ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ	32	21	55	24
<b>ମୋଟ</b>	<b>432</b>	<b>199</b>	<b>552</b>	<b>284</b>

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ)

- ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ (ଓଏଣ୍ଡଜି) ଓଡ଼ିରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ଅଭାବ ରହିଛି, ଫଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମରାମତି କିମ୍ବା ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ୟୁବୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ସେଟ୍‌ର ଅଭାବ ସହିତ, ବାୟୋପସି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଟିସୁ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଶରୀର ଭିତରୁ ଟିସୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରେଜେକ୍ଟୋସ୍କୋପ୍, ଅପରେଟିଭ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍, ସର୍ଜିନ ଷ୍ଟେରିଓସ୍କୋପିକ୍, ସର୍ଜିକାଲ ଏରିଆରେ ଥିବା ଛୋଟ ଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚମାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ପ୍ରତିଛବି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ।
- ସର୍ଜିରୀ ଓଡ଼ିରେ ସିଷ୍ଟୋସ୍କୋପ୍ ଏବଂ ରେଜେକ୍ଟୋସ୍କୋପ୍ ଭଳି ଉପକରଣ ନଥିଲା, ଟ୍ୟୁମର ଖୋଜିବା ଏବଂ ଟିସୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକାଲ୍ ସମସ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନମନୀୟ ଭିଡିଓ କଲୋନୋସ୍କୋପ୍, ସର୍ଜିକାଲ୍, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ସମୟର ଇଣ୍ଡା ଅପରେଟିଭ୍ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ସି-ବାହୁ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ।
- ଆଖିର ସର୍ଜିକାଲ୍ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ପିଆର୍ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଓଡ଼ିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉପକରଣ ନାହିଁ, ଆଖି ଚାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଗଲୁକୋମା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଗଲୁକୋମା ସେଟ୍, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଆଖିପତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡୋପିଆନ୍ ସେଟ୍ ।
- ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ଓଡ଼ିରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧତା ନାହିଁ, ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଲମ୍ବା ହାଡ଼ ମରାମତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ନେଲିଂ ସେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ । ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼କୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଏବଂ ଆଲାଲ୍‌ଜେଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଫିକ୍ସେସନ୍, ଅସ୍ଥିରେ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କରିବା, ଇମ୍ପୋମୋବାଇଲାଲ୍‌ଜେସନ୍, ଝରୁ/ ତାର/ ପ୍ଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ନିମୋନିଆ ଟ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ରିମର୍ ।

ଏହିପରି, ମୌଳିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ପାଞ୍ଚୋଟି ଓଡ଼ିରେ ସମୀକ୍ଷା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ତଥା ତାଙ୍କରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତତା ଆଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।

### 4.2.6 ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି

ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍, ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍, ପିଏମ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପ୍ରାୟ 57 ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିନୋଟି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ (ଭଦ୍ରକ, ଦେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼) ର ଉପ-ଷ୍ଟୋରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ । କିଛି ଉଦାହରଣ ସାରଣୀ 4.19 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.19: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉପ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯତ୍ନପାତି

ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍	ଉପକରଣର ପ୍ରକାର	ଉପକରଣ ସଂଖ୍ୟା	ଯତ୍ନପାତି ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
ଭଦ୍ରକ	29	456	174.53
ଢେଙ୍କାନାଳ	17	423	192.60
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	11	747	87.07
<b>ମୋଟ</b>	<b>57</b>	<b>1,626</b>	<b>454.20</b>

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲେ ଯେ:

- ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଲାପାରୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍କାନିଂ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 20.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ପୁରୀର ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ ଠାରେ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ଥିଲା । ସେହିଭଳି, ନଭେମ୍ବର 2021 ରେ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ରେମିଡିଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାଣ୍ଟି କ୍ୟାମେରା (4.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଚକ୍ଷୁ ସହାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ନହେବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
- ଦୁଇଟି ଦତ୍ତ ଏକ୍ସ-ରେ ମେସିନ୍ ମାନବ ସମ୍ବଳ/ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ଅଭାବ ହେତୁ ଭଦ୍ରକ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ରେ ରେଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗରେ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏକ୍ସ-ରେ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଦାକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍ରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରୋଗୀମାନେ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରୋଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ।
- ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଏଡର୍ଲି (ଏନ୍‌ପିଏଚ୍‌ସିଇ) ଅଧିନରେ, 20.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା ଆଠ ପ୍ରକାରର ଫିଜିଓଥେରାପି ଯତ୍ନପାତି, ନଭେମ୍ବର 2020 ମସିହାରେ ଚାରିଟି ପିଏଚ୍‌ସି ଏବଂ ସାତଟି ସିଏଚ୍‌ସିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଦୁଇଟି ସିଏଚ୍‌ସି (ବରପଦା ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର) ରେ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଏହି ଫିଜିଓଥେରାପି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ 2021 ପର ଠାରୁ ସଂପ୍ଲାପିତ ବିନା ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
- ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସିଏଚ୍‌ସି/ ପିଏଚ୍‌ସି କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରେତର ଏବଂ ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍‌ଗୁଡ଼ିକ, ଆବଶ୍ୟକ ଭିଡିଓମି ଯଥା ଯତ୍ନପାତି ରଖିବା ପାଇଁ କୋଠା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପାଇଁ ତିନି ଫେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବରୁ ସଂପ୍ଲାପିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ସେହିଭଳି, କୋଭିଡ୍-19 ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଅମ୍ଳଜାନ କଂସେନଟ୍ରେଟର, ମଲ୍ଟିପାରା ମନିଟର ଇତ୍ୟାଦି, ଭିଡିଓମି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ହେତୁ ସଂପ୍ଲାପିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ।
- ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସିଏଚ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 199 ଟି ଉପକରଣ ଯଥା ସେମି ଅଟୋ ଆନାଲିଜର, ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର, ଦାକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଅମ୍ଳଜାନ କଂସେନଟ୍ରେଟର, ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଭିଡିଓମି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡିଓମି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନ ଯୋଗାଇ, ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯତ୍ନପାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଣସଂପ୍ଲାପିତ ରହିଥିଲା ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଜାଗାର ଉପଲବ୍ଧତା, ଯତ୍ନପାତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଲିମ୍‌ପ୍ରାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ

ଏବଂ ଏକ୍ସପାନସି ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ରୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇପିଏଚ୍ ଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

**4.2.6.1 କ୍ରୟ ପରେ ଯତ୍ନପାତ୍ର ଏମ୍ସି ଏଚ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା**

ରେକର୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ସି ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏବଂ ଅଣ-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିଭାଗର ମିଳିତ ସରଜନିନ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ **ପରିଶିଷ୍ଟ 4.2** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 553 ଟି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 17.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ/ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅନୁମତି, ରିଏଜେକ୍ଟର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଏହିପରି କିଛି ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ନହେବା, **ସାରଣୀ 4.20** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ 4.20: ଯତ୍ନପାତ୍ର ବିବରଣୀ, କ୍ରୟ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା**

କ୍ର.ସଂ.	ଯତ୍ନପାତ୍ର	ନିଶ୍ଚିତ ଅବଧି	ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କ୍ରୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ବ୍ୟବହାର ହେବାର କାରଣ
<b>ପିଆର୍ ଏମ୍ ଏମ୍ସି ଏଚ୍, ବାରିପଦା</b>					
1	ଫିଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗରେ 15 ଡେଲିଭ୍ ବାଥ, 3 ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲ୍, 3 ଟି ବଡ଼ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଡିମୋଗ୍ରାଫ୍	ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2020	1.20	ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ଠାରୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିଲା
2	ଗ୍ୟାସ୍ ଆନାଲାଇଜର	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020	0.40	ଯୁକ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ	ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିଲା
3	ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ୧୫ ଟି ଉପକରଣ ଯଥା ଆକ୍ଟିମିଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫ୍ ଇତ୍ୟାଦି	ଡିସେମ୍ବର 2017 ରୁ ଜୁଲାଇ 2020	0.37	ପିଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ	ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିଲା
4	୧୪ ବାୟୋଜେନିଷ୍ଟ୍ ଉପକରଣ (ଆଇସ୍ ଲାଇଣ୍ଡ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଏଲିସା ରିଡର, ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି)	ଡିସେମ୍ବର 2017	0.21	ପିଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ	ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିଲା
5	ଅଗୋପସି ଟେବୁଲ୍, ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସହିତ ଅଗୋପସି, ଚାରୋଟି ବଡ଼ି ମର୍ଗାରା ଚାମର ଇତ୍ୟାଦି	ଡିସେମ୍ବର 2017 ରୁ ଜୁନ୍ 2020	0.70	ଶିବ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ	ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ଅଭାବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିଲା
6	ଆରଇଟିସିଏମ୍ ଏମ୍ସି ଏଚ୍ ଟିଜିଟାଲ୍ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ	ଡିସେମ୍ବର 2019	1.41	ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ, ରେଟିନା ଏବଂ ଭିତର ଚାମରର ରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ	ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିଲା
<b>ଏମ୍ସି ଏଚ୍ ଏମ୍ସି ଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର</b>					
7	ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସହିତ 25 ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର	April 2021	0.26	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ	ଲ୍ୟାବ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିଲା



କ୍ର.ସଂ.	ଯନ୍ତ୍ରପାତି	ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବଧି	ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କ୍ରୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ବ୍ୟବହାର ନ ହେବାର କାରଣ
8	ପାଥୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଜଳ ବିଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	0.17	ଜଳର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ	ଜାଗା ଅଭାବ ହେତୁ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇନାହିଁ
9	ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ବାୟୋ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର	ଏପ୍ରିଲ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2020	0.07	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି	ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇନଥିଲା
10	ମଲ୍ଟି-ଡିସପ୍ଲିନାରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ରକୋଷ ଗୋଟିଏ CO <sub>2</sub> ଇନ୍-କ୍ୟୁବେଟର ଗୋଟିଏ ଶେକର	June 2019 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	0.30	ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ	ଅନୁସନ୍ଧାନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ହେତୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଥିଲା
<b>ମୋଟ</b>			<b>5.09</b>		

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଏବଂ କେପିଆଇର ନଥିବୁ)

ନିଷ୍କ୍ରିୟ / ଖରାପ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ:



ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦାରେ ଏଲିସା ରିଡର (20 ଏପ୍ରିଲ 2022)



ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ (13 ଏପ୍ରିଲ 2022)

ଏହିପରି, ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ କ୍ରୟ ସଂସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନକରି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡିଭିଡି, ରିଏଜେକ୍ସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ଫଳସରୂପ, ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଏହିପରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା କେବଳ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନକାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ହେଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ସଂପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କ୍ରୟ ଉପକରଣକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନରଖି ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

**4.2.6.2 କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗରେ କ୍ୟାଥ ଲ୍ୟାବର ବ୍ୟବହାର ନହେବା**

ଅଗଷ୍ଟ 2012 ରେ ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ଇନଡୋର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (ଅକ୍ଟୋବର 2012) ଉକ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ତିନିଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଥିଲା । ସୁପରିଣ୍ଡେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଏମ୍‌କେସିଜି, ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବିଲ୍ଡିଂ ନଅ ବର୍ଷ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ଡିସେମ୍ବର 2021 ରେ, ସିମେନ୍ଟ୍ ହେଲ୍ଡ କେମ୍ବର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ରାଉରକେଲା, କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗର କ୍ୟାଥ ଲ୍ୟାବକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମିଳିତ ସରକାରିନ ଡଡ଼ (8 ଜୁଲାଇ 2022) ସମୟରେ, କ୍ୟାଥ ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 3.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।



ଏମ୍‌କେସିଜି, ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ଯୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଲିଥୋଟ୍ରିସ୍ଟି ମେସିନ୍ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଛି (29 ଜୁଲାଇ 2022)

ପୁନଶ୍ଚ, କିଡ଼ନୀରେ ଥିବା ପଥରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲିଥୋଟ୍ରିସ୍ଟି ମେସିନ୍ (3.22 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଇଣ୍ଡୋର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାପିତ (ନଭେମ୍ବର 2014) ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଯଦିଓ ଯୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ନୂତନ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା (ପିଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଓଇ) କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) କରାଯାଇଛି ।

**4.2.7 ଉପକରଣର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ**

ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସବୁଜନକୁ ସୁଧାରି ସୁଲଭ ତଥା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଚରସିଗାରି ସେବା ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାରେ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା (ପିଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଓଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସୁପର ସ୍ୱେସିଆଲିଟି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତୃତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ରେ ପିଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଓଇ, ଫେଜ III, 150 କୋଟି ଟଙ୍କା<sup>101</sup> ବ୍ୟୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ସୁଦ୍ଧା ସିଭିଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ରୟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସ୍ଥାପିତ ଇତ୍ୟାଦି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ୱେସିଆଲିଟି ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ 2020 ରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୁଲାଇ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସୁପର ସ୍ୱେସିଆଲିଟି ବ୍ଲକ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ 233ଟି ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରୁ 210ଟି ଫେବୃଆରୀ 2018 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2022 ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 23 ଉପକରଣ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା 210ଟି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ 52ଟି ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 8.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନାହିଁ ଏବଂ 70ଟି ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ (7.44 କୋଟି ଟଙ୍କା) ବ୍ୟବହାର

<sup>101</sup> ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ: 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ: 30 କୋଟି ଟଙ୍କା

କରାଯାଇନାହିଁ । (ଜୁଲାଇ 2022) ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଟୋବର 2022 ରେ ପ୍ରାୟ 65ଟି ଆସବାବପତ୍ର<sup>102</sup> ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 99.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 54 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇସିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ । ସ୍ଥାପିତ ଉପକରଣର ଏକରୁ ଚାରି ବର୍ଷ କ୍ରମେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ ନ ହେବା, ତାତ୍ତ୍ଵଗୋନାରେ ରୋଗୀ ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।

ଏହିପରି ପିଏମଏସଏସଏସ୍ ଥିଆନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ, ଚରସିଆରି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ତାତ୍ତ୍ଵଗୋନା ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, 166ଟି ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏହା ସତ୍ତ୍ଵେ ସ୍ଥାପିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

**4.2.8 ଅଚଳ ଇଆଇଏଫ୍ ର ନିଷ୍ପାସନ ନହେବା**

ଓଡ଼ିଶା ଜେନେରାଲ ଆର୍ଥିକ ନିୟମାବଳୀ (ଓଜିଇଆର) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମାନୁସାରେ, ଯୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ତ୍ତେ, ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ବଳକା ଓ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ପାସନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2020 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ମଧ୍ୟରେ ମେସର୍ସ କିଲୋଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ (କେଟିପିଏଲ) ଦ୍ଵାରା 5,771 ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 33.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପାସନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ନିଷ୍ପାସିତ/ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଇଆଇଏଫ୍ ର ନିଷ୍ପାସନ ନହେବା, ଏହା କେବଳ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜାଗା ଦଖଲ କରିନଥିଲା ବରଂ ତାତ୍ତ୍ଵଗୋନାଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।



ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ବେଙ୍କାନାଳାଠାରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଉପକରଣ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି (29 ଏପ୍ରିଲ 2022)

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ/ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପାସିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

**4.2.9 ସଂଗୃହଜନିତ ସମସ୍ୟା**

**4.2.9.1 ଇଆଇଏଫ୍ ର ଇଣ୍ଡେକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି, ପିଆରଏମ୍, ଏମସିଏଚ୍ରେ ଗଠିତ ନହେବା**

ଇଆଇଏଫ୍ ର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କ୍ରୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଅନୁଯାୟୀ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ/ ବରାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପକରଣ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଏମସିଇଏମସି)<sup>103</sup> ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ । ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଏମସିଇଏମସି

<sup>102</sup> 52.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମଗାଳିତ ଶଯ୍ୟା (30); 36.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗାଳିତ ଶଯ୍ୟା (25); ଏବଂ 10.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗ୍ରଲି (10)  
<sup>103</sup> ଡିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯିଏକି କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି

ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାଲିକା ରୂପାନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଏକାକୃତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପରିଚାଳନା କମିଟି (ସିଇଏମସି) ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୱରାମ୍ୟାନେନେମେଣ୍ଟ ଯୁନିଟ୍ (ଏସଡିଏମୟୁ) କୁ ପଠାଯିବ ।

ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାଲିକାକୁ ବୈଧ କରିବାକୁ ପିଆରଏମ ଏମସିଏବ୍, ଏକ ଏମସିଏଏମସି ଗଠନ କରିନଥିଲେ । ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମାନେ କୌଣସି ବୈଧତା ବିନା ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ (ଡିଏମଇଟି)ର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପଠାଉଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉପକରଣର ପ୍ରାଥମିକତା/ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନୁକ୍ଷେପ 4.2.6.1 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା , ପରି ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ନିଷ୍ପ୍ରୟ ରହିଥିଲା । ଅନୁ ପଟେ ଉଭୟ କ୍ଲିନିକାଲ ଏବଂ ଅଣ-କ୍ଲିନିକାଲ ବିଭାଗରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ଅଭାବର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକ୍ଷେପ 4.2.5 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ପିଆରଏମ୍ ଏମସିଏବ୍‌କୁ ଇଆଇଏଫ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

**4.2.9.2 ଏମକେସିଜି ଏମସିଏବ୍‌ରେ ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ**

ଏସଇଏମସିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ଇଆଇଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ତରରେ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ର ବିଦ୍ୟମାନ ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିବାକୁ ହେବ ।

ଅଧିକତ୍ରୁ ସରକାରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ୍ ଫ୍ଲୋସ୍ (ଜିଇଏମ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଖୋଲା ବିଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ରୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା କିଣାଯାଇଥିବା ଆଇଟମ୍ ଜିଇଏମ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଖୋଲା ବିଡିଂରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ ।

ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା:

- **ସିଇଏମସି/ଏସଏଲପିସି ର ଅନୁମୋଦନ ବିନା କ୍ରୟ:** ଡିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2016 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2021 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମକେସିଜି ଏମସିଏବ୍ ବୁକ୍ସପୁର, 38 ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ (426 ନମ୍ବର) ଏସଇଏମସିର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦାଖଲ ନ କରି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କ୍ରୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୟ ଏଜେନ୍ସି ଯଥା ଓଏସଏମସିଏଲ୍ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 841 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ନିଜ ସ୍ତରରେ କ୍ରୟ ହେତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପସନ୍ଦ, ମାନବ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆବଶ୍ୟକ, ସିଇଏମସି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନୁକ୍ଷେପ 4.2.6.1 ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାନବ ସମ୍ବଳଇତ୍ୟାଦି ଅଭାବ ହେତୁ କିଛି କ୍ରୟ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।
- **ଅଧିକ ହାରରେ ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟ:** ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2021 ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା 12ଟି ଆଇଟମ୍ (3ଟି) ଅତିରୁ, ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ 12ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରୟ ହାର ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ର ରୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ 9.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 4.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
- **ଜିଇଏମ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବାହାରେ କ୍ରୟ:** ମଇ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୟ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଡିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମକେସିଜି ଏମସିଏଲ୍ ସରକାରୀ



ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସତ୍ତ୍ୱେ 277 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ଜିଇଏମ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧତା ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରି କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କ୍ରୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ଯେ କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଇଏମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଖୋଲା ନିତିଂରେ ଆବିଷ୍କୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜିଇଏମ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା ଯଦିଓ ଏହା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ତେଣୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିପରୀତ ଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମସିଏବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଇଆଇଏଏଫ୍ କ୍ରୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା ।

ସାମ୍ବୁ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

**4.2.10 କୋଭିଡ-19 ପରିଚ୍ଛେଦନା ପାଇଁ ଯତ୍ନପାତ୍ର କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ**

ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସେବା ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ (ଓଏସଏମସିଏଲ୍) ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯତ୍ନପାତ୍ର କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅମ୍ଳଜାନ କନସେନଟ୍ରେଟର, ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ଇତ୍ୟାଦି ସାମ୍ବୁ ସେବା ସୁବିଧା ସମେତ ଉତ୍ତରୀକୃତ କୋଭିଡ -19 ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ନିୟୁତ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ଥିଲା । ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣଯାଇଥିବା ଉପକରଣର ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 4.21 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ 4.21: କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଯୋଗାଣଥିବା ଉପକରଣ**

ଉପକରଣର ନାମ	ପରିମାଣ କ୍ରୟ/ ଗ୍ରହଣ				ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ
	ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି	ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ/ ଜିଓଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ	ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ	ସମୁଦାୟ	
ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର	423	707	230	1,360	1,235
ଅମ୍ଳଜାନ କନସେନଟ୍ରେଟର	7,516	936	2,903	11,355	9,238
ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର	29,282	35,741	11,001	76,024	37,898
<b>ମୋଟ</b>	<b>37,221</b>	<b>37,384</b>	<b>14,134</b>	<b>88,739</b>	<b>48,371</b>

(ଉତ୍ସ: ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ:

- କୋଭିଡ-19 ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଏସଏମସିଏଲ୍ 13 ଟି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 402 ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର (ମୂଲ୍ୟ<sup>104</sup>: 11.77 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା । କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ପରେ ଏହି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର<sup>105</sup> କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା । ତେବେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହିପରି 10 ଟି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଜେପିଆଇ ସମୟରେ, ଏହି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ବୋକାଳରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
- ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ସାତଟି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 930 ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର (ମୂଲ୍ୟ<sup>106</sup>: 88.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ

<sup>104</sup> ଜିଓଆଇ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣଯାଇଥିବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପାଇଁ ସୁନିର୍ଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇ ସୁନିର୍ଦ୍ଧ ପିଛା 2,92,905 ଟଙ୍କାରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି

<sup>105</sup> ସାମ୍ବୁ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମଲପୁରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବୁଝିନାମା ଅନୁଯାୟୀ

<sup>106</sup> ଜିଓଆଇ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣଯାଇଥିବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପାଇଁ ସୁନିର୍ଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇ ସୁନିର୍ଦ୍ଧ ପିଛା 9,569 ଟଙ୍କାରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି



ନଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ, ଏହି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ଜେପିଆଇ ସମୟରେ (ମଇ-ଜୁଲାଇ 2022) ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସିଲିନ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଓଏସଏମସିଏଲକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

- ଓଏସଏମସିଏଲ 12ଟି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 817 ମଲ୍ଟି-ପାରାମିଟର<sup>107</sup> ଯୋଗାଇଥିଲା, (ମୂଲ୍ୟ 10.95 କୋଟି ଟଙ୍କା) <sup>108</sup> ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସୁଚିତ ଥିଲା ।
- ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚଏଚ ଗୁଡ଼ିକ କୋଭିଡ-19 ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 84ଟି ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, 2.081 ଅମ୍ଳଜାନ କନସେନଟ୍ରେଟର ଏବଂ 122 ମଲ୍ଟି ପାରା ମିଟର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଆଇସିୟୁ ସୁବିଧା , ମାନବ ସମ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଭାବ ହେତୁ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିନଥିଲା ।
- ଓଏସଏମସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚଏଚ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟିକୁ 84 ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଡିଏଚଏଚ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ 64 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରସିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି 20ଟି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅସଙ୍ଗତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ, ଯାହାକି କୋଭିଡ-19 ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । ଅଧିକତମ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମାନବ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଯତ୍ତ ନଥିବାର ଡିଏଚଏଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ଘରୋଇ କୋଭିଡ-19 ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ କୌଣସି କ୍ଷତି / ଅବନତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

**4.2.11 ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲୁଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା**

ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯତ୍ନ ଏକ ଉପାଦାନ । ଏହା ଅସ୍ୱଚ୍ଛୋପକର, ସହିତ ଉତ୍ତମ କୁନିକ୍ ଏବଂ ତାହା ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାର ଅମ୍ଳଜାନର ଉପଲବ୍ଧତା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା । ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ 82 ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲୁଷ୍ଟ<sup>109</sup> (ପିଏମ୍ ସିଏଆରଇଏସ୍ ପାଣ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ରିଭୁକ୍ତ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ।

ବିଭାଗ ସିଭିଲ ନିର୍ମାଣ, ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରର (ଡିଜି) ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କ୍ରିୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ (ଏମଜିପିଏସ୍) କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍କସ (ଆର ଏଣ୍ଡ ବି) ବିବାଗକୁ 58.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ପ୍ଲୁଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାପ୍ସିଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଏହିପରି ଏକ ଘରୋଇ କ୍ୟାପ୍ସିଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଥିବା ଦିନକୁ ଦିନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଧାନ କରିବ ।

<sup>107</sup> ମଲ୍ଟି ପାରା ମିଟର, ପେରିଫେରାଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍/ ନନ୍-ଇନ୍ଭେସିଭ୍ ବ୍ଲୋପ୍ରେସର/ ଟେମ୍ପରେଚର ଭଳି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ମାପ କରେ ଏବଂ ଦର୍ଶାଏ

<sup>108</sup> 1.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତି x 817 ଟି

<sup>109</sup> ପିଏମ୍ କେୟାରସି: 39; ରାଜ୍ୟ ସିଏସ୍ଆର: 30; ପେଡ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମକ୍ଷାଳୟ: 09; ରେକର୍ଡାଲ ମକ୍ଷାଳୟ: 04

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 82 ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 81 ଟି ଜୁନ 2021 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2022 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 4.22 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.22: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ନାମ	ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ	ପିଏମ୍ କେନ୍ଦ୍ର	ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଡି	ସ୍ଥାପନ ତାରିଖ
ଭଦ୍ରକ	2	1	1	ନଭେମ୍ବର 2021
ଢେଙ୍କାନାଳ	1	1	-	ଅକ୍ଟୋବର 2021
କନ୍ଧମାଳ	2	1	1	ଜୁନ୍ 2021/ ଜାନୁଆରୀ 2022
ନବରଙ୍ଗପୁର	1	1	-	ଜୁଲାଇ 2021
ନୂଆପଡ଼ା	1	1	-	ଜୁଲାଇ 2021
ପୁରୀ	2	1	1	ଅଗଷ୍ଟ 2021
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	1	1	-	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ:

- ତିନିଟି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ (ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼)ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ।
- ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ଅଭାବ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା ।
- ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପ୍ ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା, ମେଡିକାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଟିସିସିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କମ୍ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ନୂତନ ନିର୍ମିତ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିବାରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ/ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡି ଯୋଗାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ମେଡିକାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍‌ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଭଳି ଭିଡିଓଫିକୁ ମଜବୁତ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

#### 4.2.12 ଉପକରଣର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାସ୍ତ୍ରୀସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2020 ଠାରୁ, ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ 29 ଡିସେମ୍ବର 2020 ରେ ମେସର୍ସ କେଟିପିଏଲ୍ ସହିତ ଏକ ରୁକ୍ତନାମା କରିଥିଲା ।

ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ, ଅତିରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା:

- **ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ:** ରୁକ୍ଷିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତିନି ଜଣ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବାର ଥିଲା । ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ (କେଟିପିଏଲ୍) ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେକ୍ତାଉନ୍/ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ/ ସମାଧାନ ସ୍ଥିତିକୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଥିଲା । ତେବେ, ପିଆର୍ଏମ୍ ଏମ୍ସିଏସ୍ରେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନ ଥିବାବେଳେ ଏମ୍କେସିଜି ଏମ୍ସିଏସ୍ରେ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଫେବୃଆରୀ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍କେସିଜି ଏମ୍ସିଏସ୍ ରେ 84.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ 29 ଟି ଅଭିଯୋଗର ଜୁଲାଇ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି 'କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ' ପ୍ରଦାନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏମ୍ସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀ ସେବା ଓ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।

- **ଡାଲିମ୍ ଦିଆନଯିବା:** ରୁକ୍ଷିନାମାର ସର୍ଭାଇଭା ଅନୁଯାୟୀ, ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ମେସର୍ସ କେଟିପିଏଲ୍) ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଥର କିମ୍ବା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉପଭୋକ୍ତା ଡାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ, ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍ସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

- **ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ:** ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ପିଆର୍ଏମ୍ ଏମ୍ସିଏସ୍ରେ ସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କାଲିବ୍ରେସନ୍ କରିନଥିଲେ । ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନକରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 10.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କୋଲ୍ଡ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପାରାଫିନ୍ ଏମେଡିଂ ବାଥ୍ (କେଟିପିଏଲ୍ ବାରକୋଡ ନମ୍ବର 135380 ଏବଂ 135376), ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ, ଅପ୍ରେଲ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ।

- **ଏମ୍କେସିଜି ଏମ୍ସିଏସ୍ ରେ 2.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଚଳ ଉପକରଣ:** 16 ଜୁଲାଇ 2022 ସୁଦ୍ଧା, ଏମ୍କେସିଜି ଏମ୍ସିଏସ୍ରେ 2.06 କୋଟି ଟଙ୍କା (**ପରିଶିଷ୍ଟ 4.4**) ମୂଲ୍ୟରେ 65 ଟି ଉପକରଣ ଏକ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 50 ଟି ଉପକରଣ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ରାରେଣ୍ଟ୍ ଅଧିନରେ ଥିବାବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା 15 ଟି ଡ୍ରାରେଣ୍ଟ୍ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଚଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ, ଯେପରିକି ଏହା କେଉଁ ଦିନରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା, କେଟିପିଏଲ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ମରାମତିର ସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି, ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଗଲା ନାହିଁ ।

ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଡାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା, ନିୟମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା, ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ମେସର୍ସ କେଟିପିଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ହେକ୍ତାଉନ୍ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପରିଚାଳନାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା/ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଖରାପ ଉପକରଣର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଗରେ ଏହାକୁ ଜଣାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

**ସୁପାରିଶ 4.2:**  
 ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧତା, ମାନବ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି ।